


SimMan 3G Trauma

Guide de configuration rapide

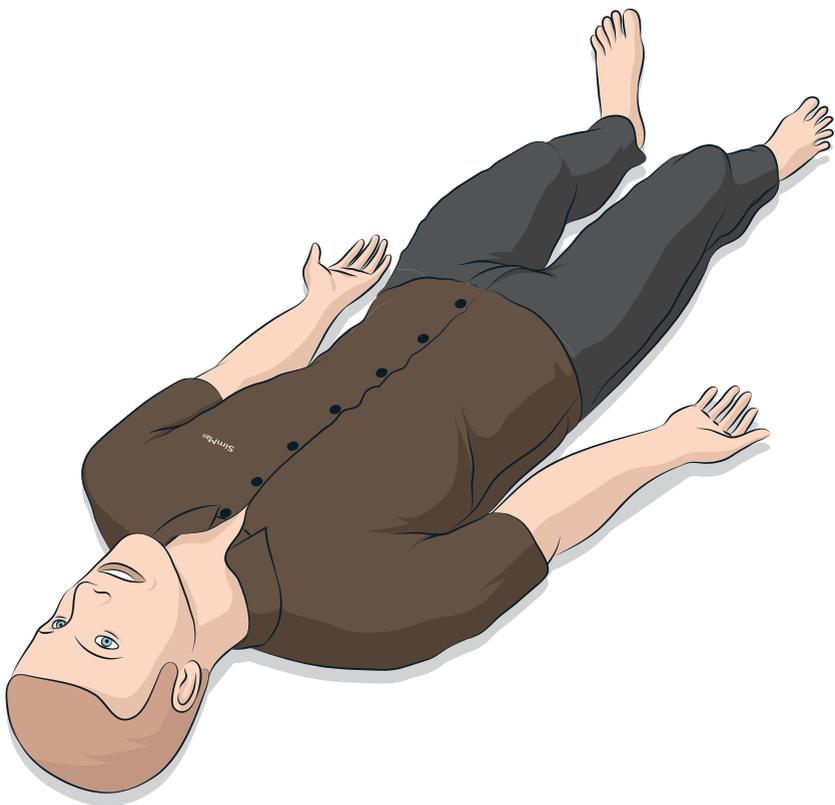


Ce guide de configuration rapide décrit l'assemblage et la configuration de votre simulateur patient SimMan. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation de SimMan, consultez les fichiers d'aide LLEAP et le mode d'emploi SimMan.

Consultez www.laerdal.com/download pour télécharger les dernières versions du mode d'emploi et du logiciel.



COMPOSANTS


Tronc




Jambes



Bras amputés



Peau de jambe droite amputée




Jambe gauche amputée



Vêtements



Organes génitaux masculins et féminins



Mode d'emploi et informations importantes sur le produit



Prothèse dentaire supérieure rigide



Tendeur pour ECG défib.



Adaptateurs pour électrode d'ECG



Joint torique pour compliance pulmonaire x 10




Unités de recharge en liquides et sang



Module de plaies



Plèvre pour module de drain thoracique x 6



Faux-sang concentré



Lubrifiant pour voies respiratoires



Brassard de prise de tension artérielle



Poche IV



Peau du cou
x 6



Coussinets et os
du tibia
x 3



Coussinets IM



Coussinets intra-osseux
et os du sternum
x 4




Talc



Pince



Filtre d'intraveineuse,
sang x 2



Coussinets en mousse IM
pour jambe



Pneumothorax



Membrane
thyrocricoïdienne




Matériel de montage



Adaptateur de
bras SimMan



Bracelet d'identification



Casque



Clavier et souris



Sonde de SpO₂



Câble Ethernet



Outils




Alimentation externe




Chargeur de batteries
x 2



Moniteur patient


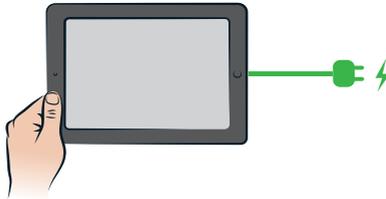





PC du formateur



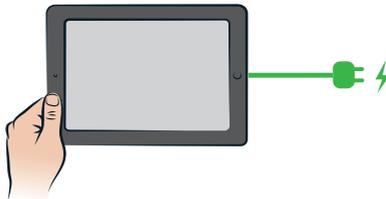



2




OUVERTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DE LA PEAU DU TORS

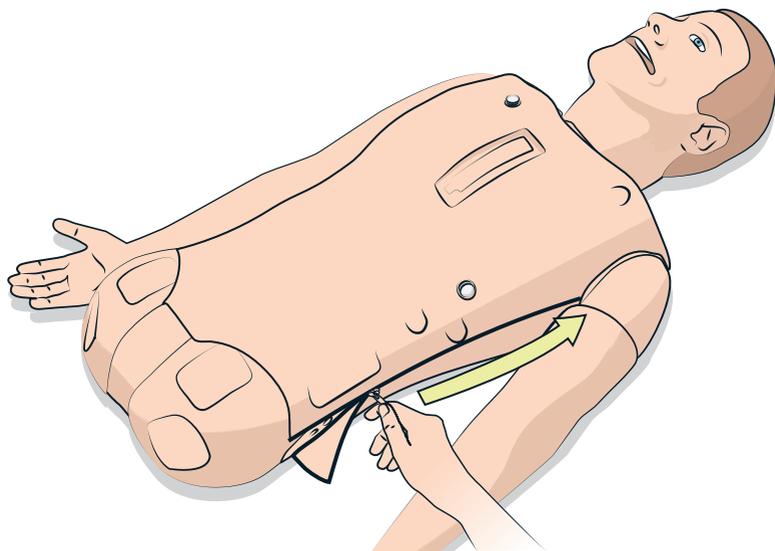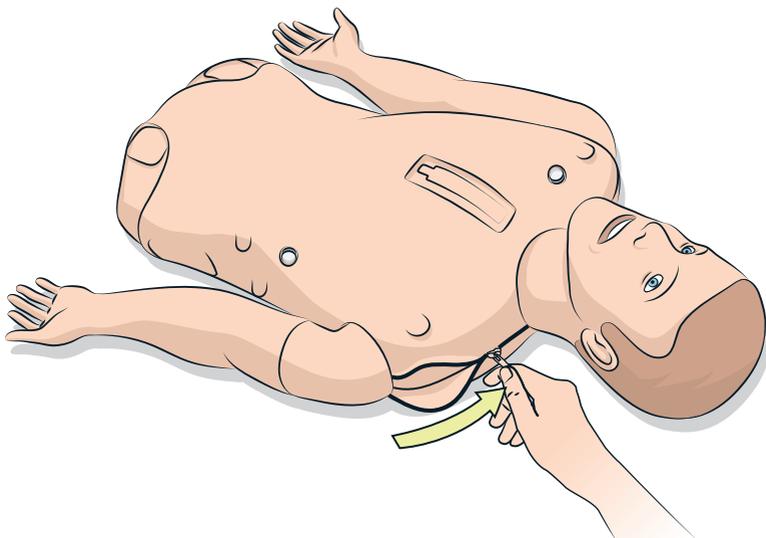


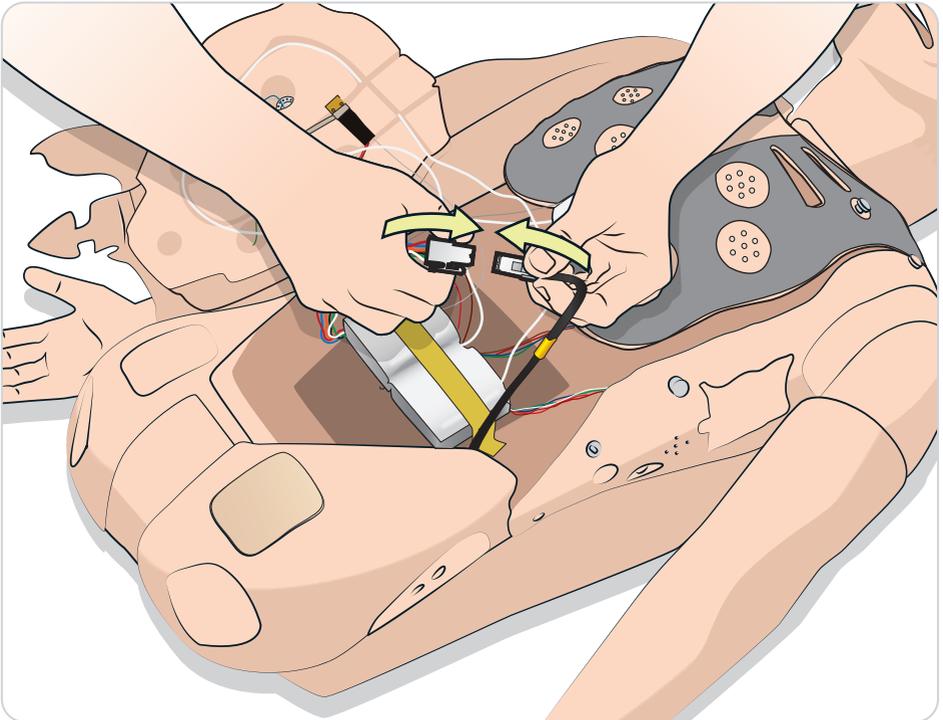
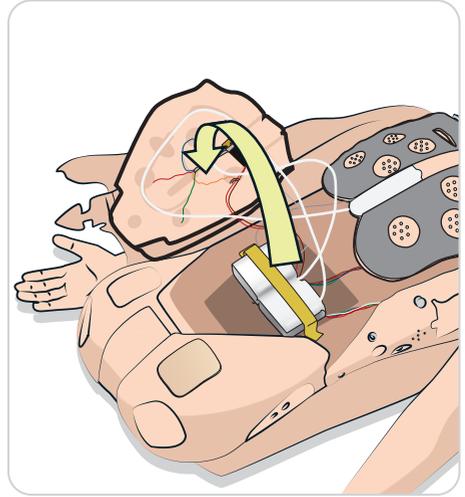
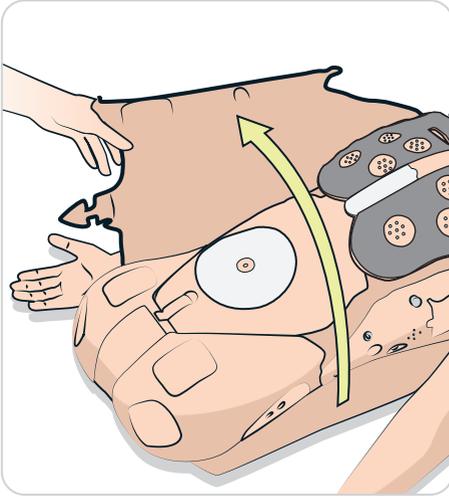


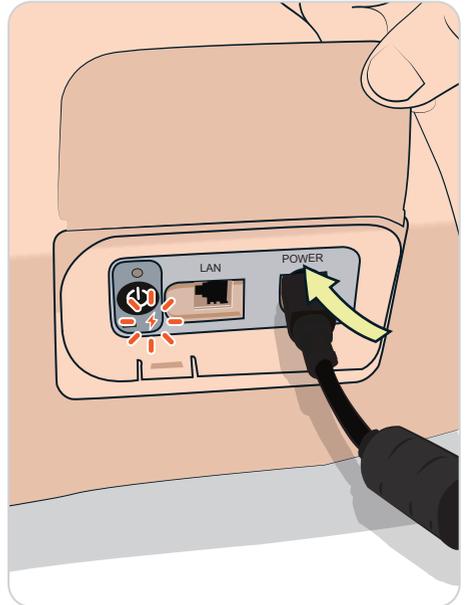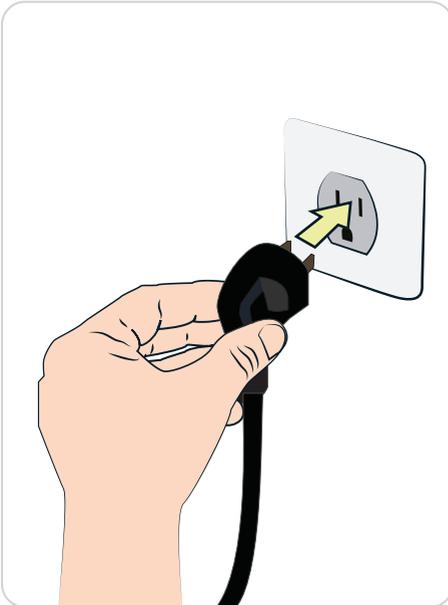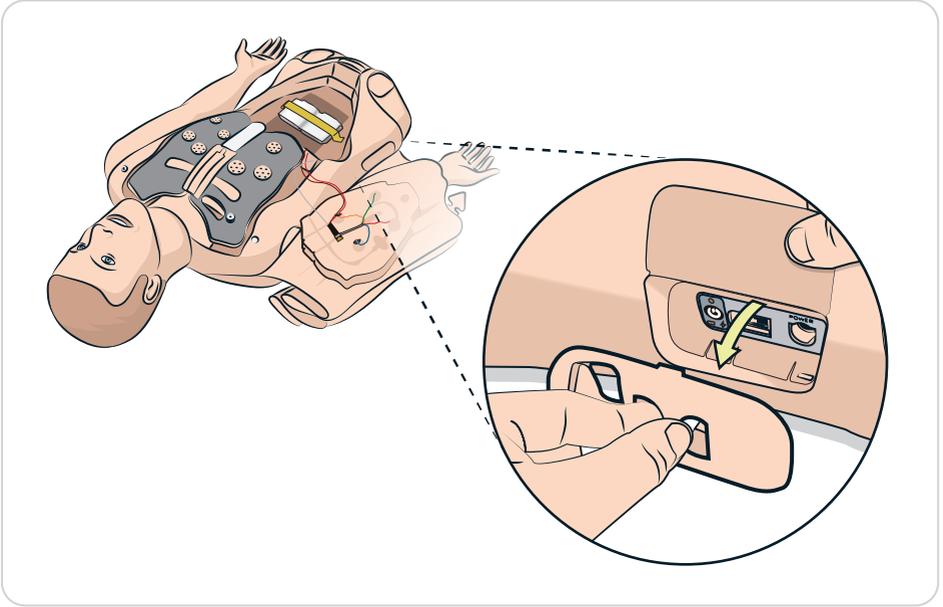

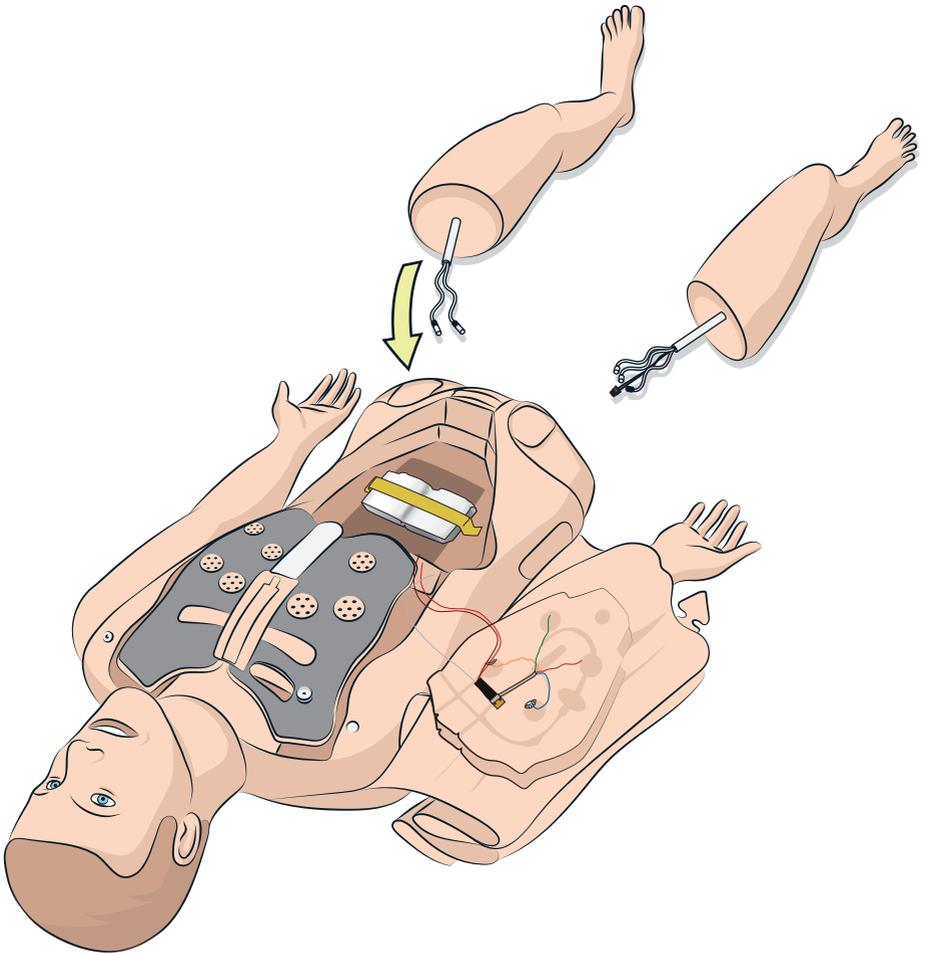

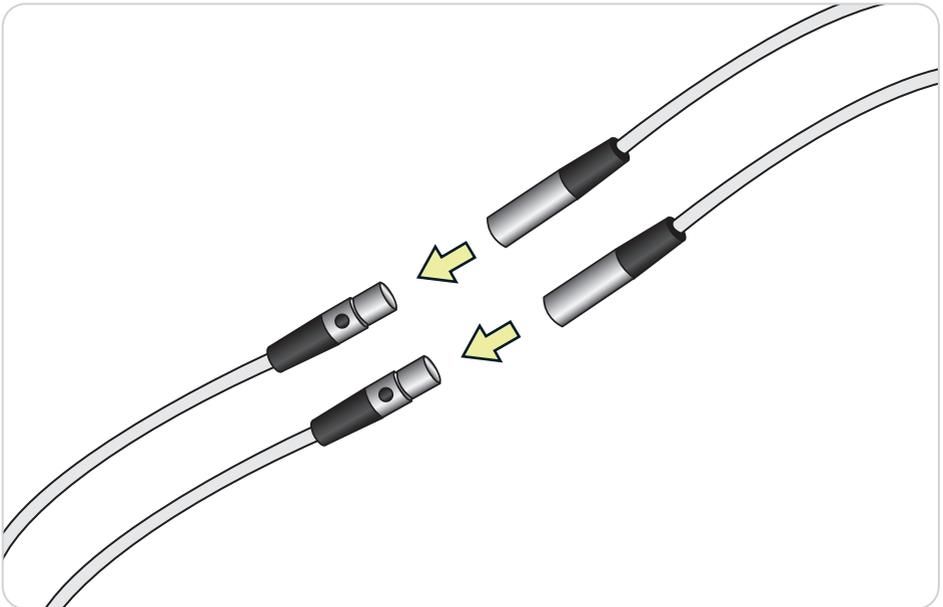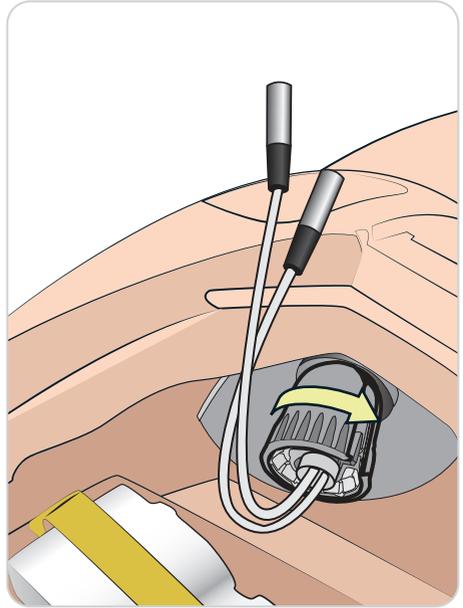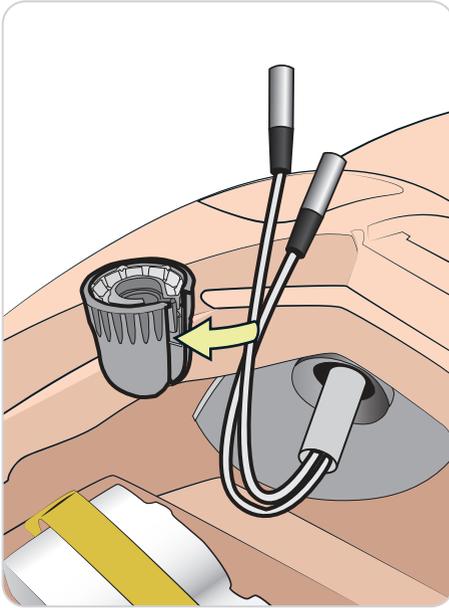

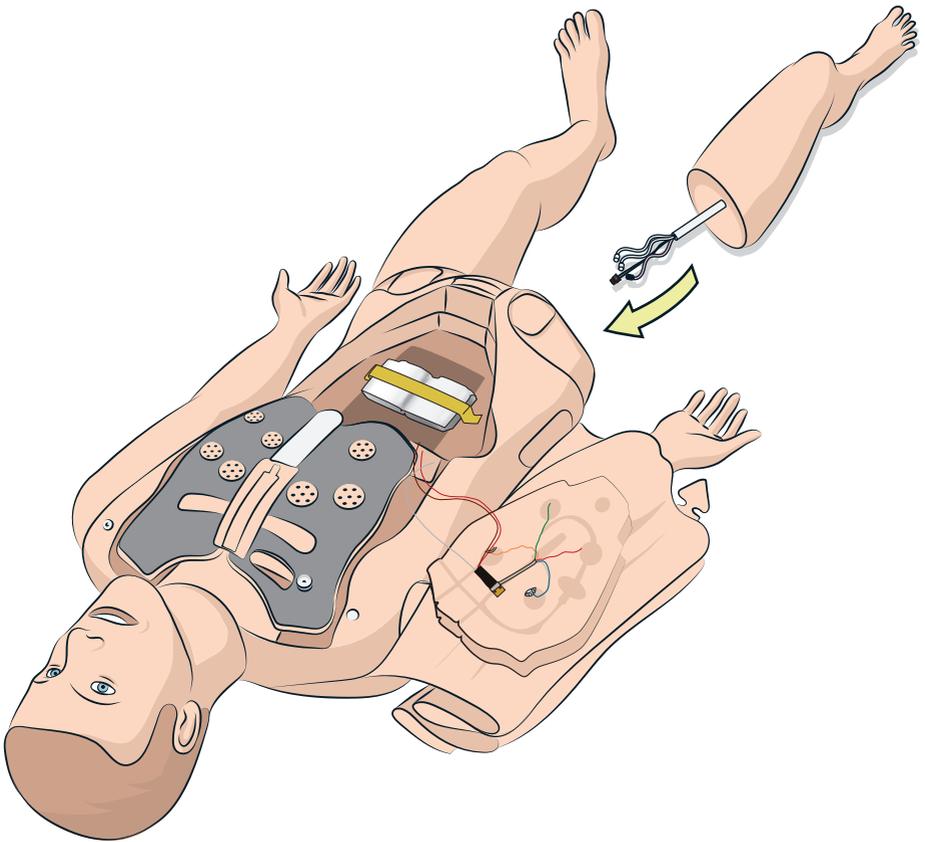

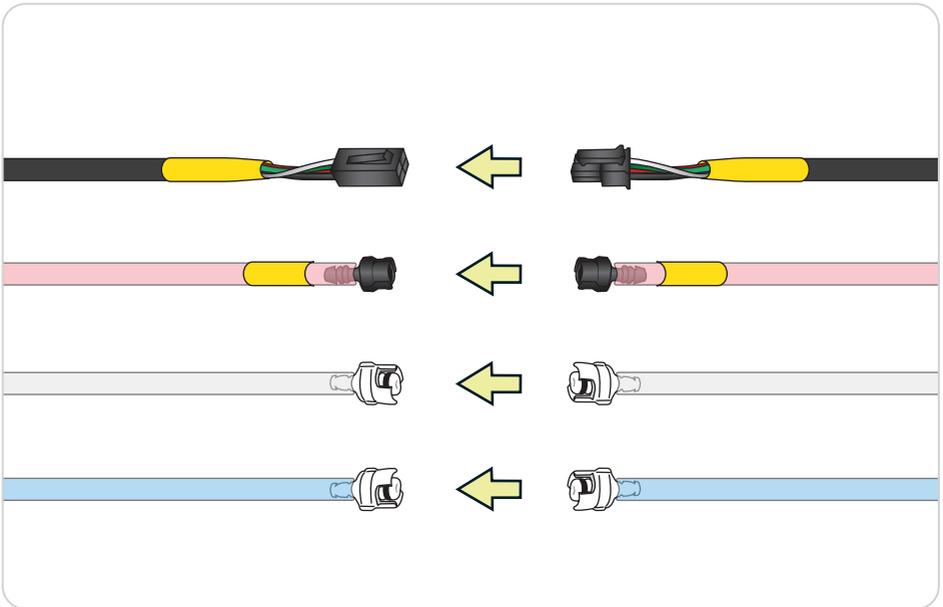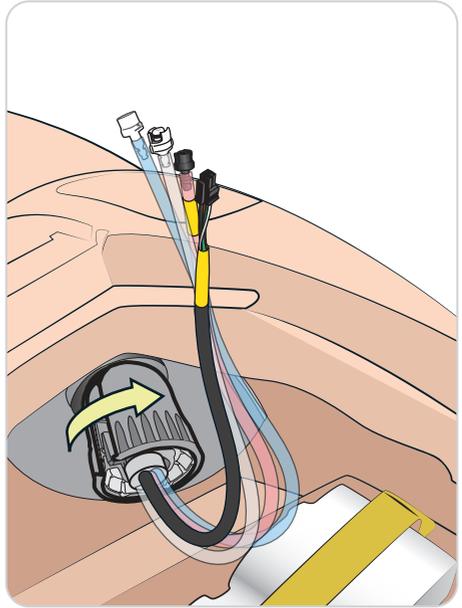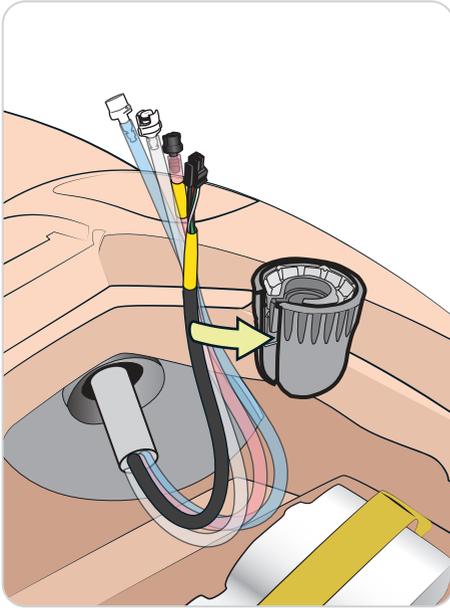

7_A

CONFIGURATION SANS FIL

Casque




PC du formateur



SpO₂



Moniteur patient

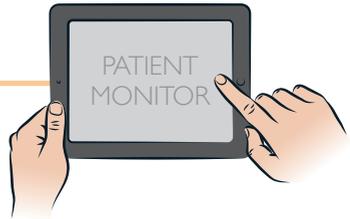

Câble USB —


7_B

CONFIGURATION AVEC CÂBLE


Casque



PC du formateur

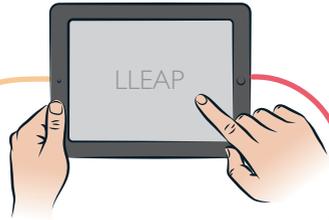



Commutateur



SpO₂



Moniteur patient

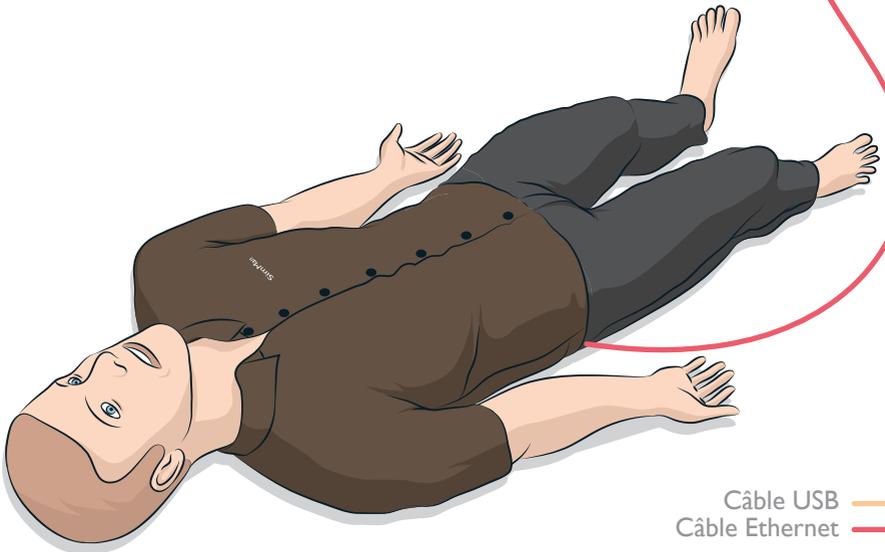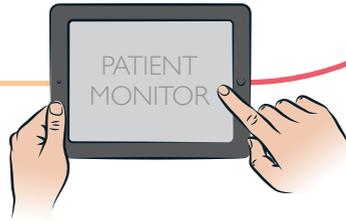

Câble USB — (orange)
Câble Ethernet — (red)

© 2016 Laerdal Medical AS. Tous droits réservés.
Printed in Norway

20-08138 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives