


SimBaby

Tracheostoma



Verwendung – Tracheostoma

Tracheostoma

Zur Durchführung von Tracheostomapflege und Notfallverfahren wählen Sie die bevorzugte Einstellung in SimPad PLUS oder LLEAP.

Verfügbare Einstellungen:


- Offen
- Partiiell
- Geschlossen
- Fehllage (Schleimstopfen)
- Intubiert




Hinweise

- *Pharyngeale Schwellung ist bei SimBaby mit Tracheostoma nicht verfügbar.*
- *Verwenden Sie nur Tracheostomatuben bis 4,0 mm ohne Cuff und bis 3,5 mm mit Cuff.*
- *Denken Sie daran, den Tracheostoma-Stopfen nach Gebrauch wieder einzusetzen.*

SimPad PLUS

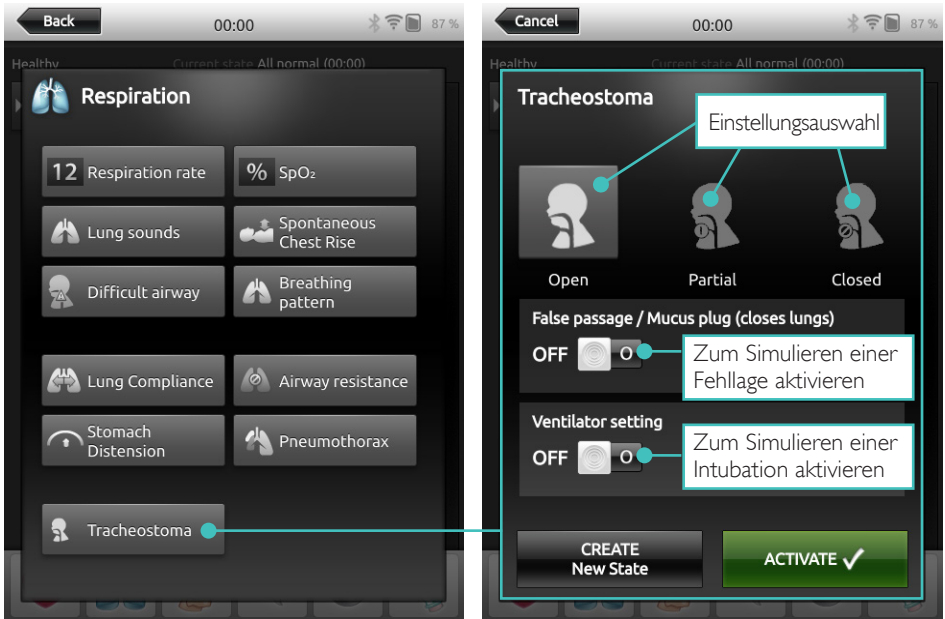

LLEAP

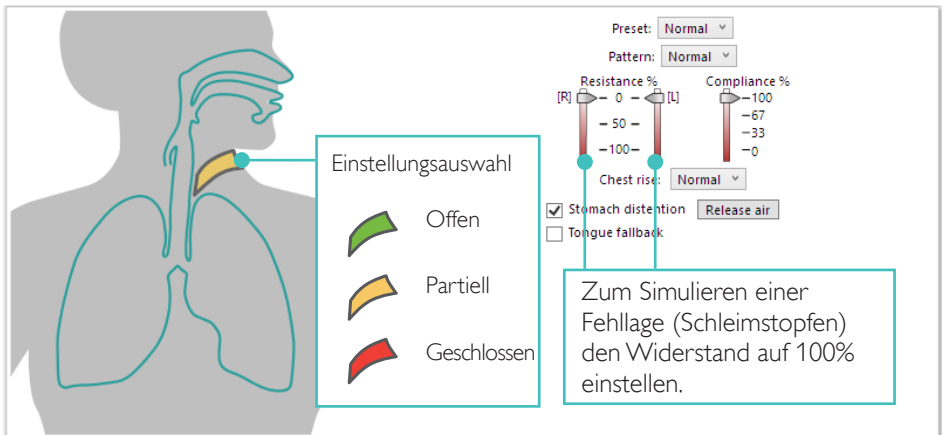

© 2020 Laerdal Medical AS. Alle Rechte vorbehalten.

Hersteller: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
Tel.: (+47) 51 51 17 00

Gedruckt in Norwegen

20-16245 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives