


# SimBaby

기관절개술



# 사용 - 기관절개술

---

## 기관절개술

기관절개술 관리 및 응급 절차를 진행하려면 SimPad PLUS 또는 LLEAP에서 기본 설정을 선택하십시오.


이용 가능한 설정:

- 열기
- 부분 열기
- 닫기
- 잘못된 경로
- 삽관됨


### 참고

- 인두 종창 기능은 기관절개술이 가능한 SimBaby에서는 사용할 수 없습니다.
- 최대 4.0mm(비 컵식) 및 최대 3.5mm(컵식) 기관절개관만 사용하십시오.
- 사용 후에는 기관절개 마개를 다시 끼우십시오.

SimPad PLUS

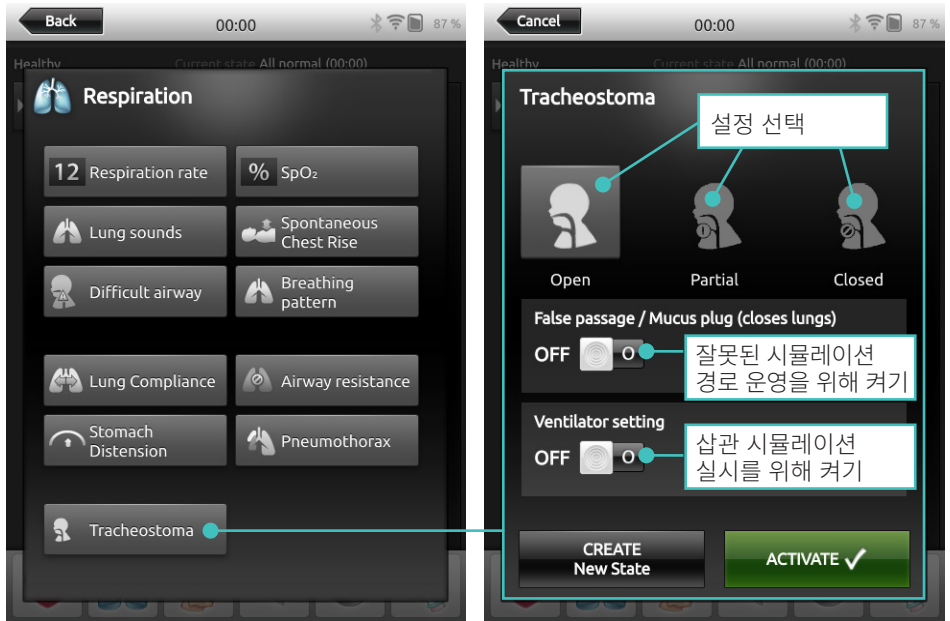

LLEAP

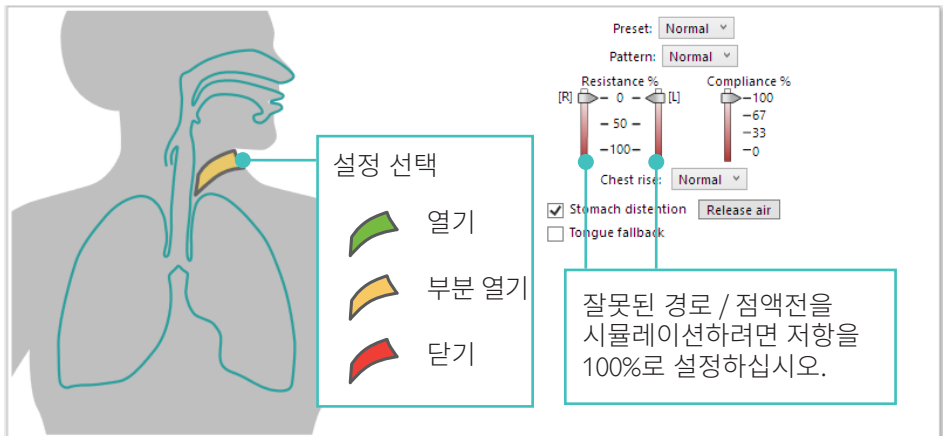

© 2020 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

제조업체: Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
전화: (+47) 51 51 17 00

노르웨이에서 인쇄함.

20-16273 개정판 A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives