

SimNewB

User Guide




Introducción	4
Descripción general y configuración del sistema	5
Elementos incluidos y almacenamiento	6
Características	7
Panel de alimentación	8
Carga	9
Conexión	10
Descripción general de los pulsos y los sonidos	11
Preparación para simulación - Inserción del módulo de meconio	12
Preparación de la simulación - Cateterismo venoso umbilical	13
Infusiones de grandes volúmenes	14
Preparación para la simulación - Pierna para tratamiento intraóseo - Infusiones de grandes volúmenes	15
Preparación de la simulación - Selección de las pupilas	16
Preparación para la simulación - Lubricación	17
Lubricación de las herramientas	17
Lubricación de SimNewB	17
Uso - Intubación	18
Uso - Ventilación	19
Uso - RCP	20
Uso - Acceso axilar medio para toracocentesis izquierda unilateral	21
Uso - Cateterismo venoso umbilical	22
Uso - Infusiones de grandes volúmenes	23
Uso - Pierna para tratamiento intraóseo	24
Uso - Ajustes de reclutamiento pulmonar	25
SimPad Plus	25
LLEAP	26
Uso - Ajustes de nivel	27
Cuidado y limpieza	28
Cuidado general	28
Piel	28
Limpieza del módulo de pierna para tratamiento intraóseo	29
Limpieza del depósito umbilical	30
Mantenimiento	32
Reparación del módulo de la pierna para tratamiento intraóseo	32
Retirada y reemplazo del módulo de la pierna para tratamiento intraóseo	33

Introducción

SimNewB es un simulador de recién nacido sin cables diseñado para ayudarle a mejorar la reanimación de neonatos y cumplir los objetivos de aprendizaje específicos de los protocolos de reanimación de neonatos. Centrándose en los primeros 10 minutos de vida, SimNewB ofrece una formación realista en intervenciones críticas.

Los elementos que se incluyen pueden variar en apariencia y están sujetos a cambios.

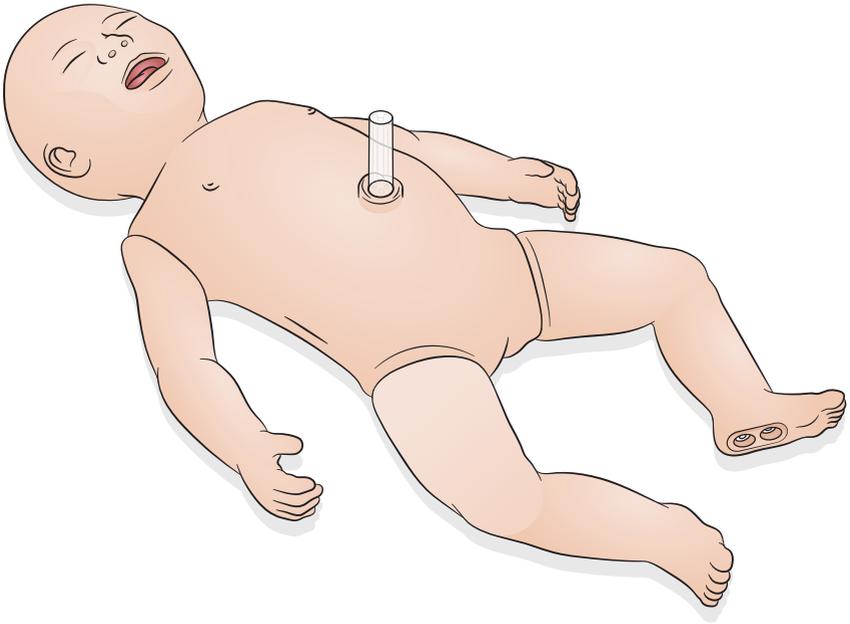

Descripción general y configuración del sistema

SimNewB puede ser controlado por el operador utilizando una tableta o PC que ejecute el software LLEAP de Laerdal o utilizando SimPad Plus que es la tableta de Laerdal.

Tanto LLEAP como SimPad Plus permiten al operador ejecutar sesiones bien utilizando los escenarios preprogramados en modo automático o en modo manual.

Utilizar LLEAP o SimPad Plus permite que se muestren las constantes vitales en un monitor de paciente simulado (opcional).

Tanto SimNewB como el monitor de paciente pueden funcionar con conexión inalámbrica.



LLEAP



SimPad PLUS




Monitor de paciente



Nota

- Buscar la Guía del usuario de SimPad PLUS en www.laerdal.com/support
- Para acceder a los archivos de ayuda de LLEAP, vaya a la sección de ayuda de la página de inicio de simulación de Laerdal
- Para obtener instrucciones de conexión detalladas, descargue la sección de la descripción general de la configuración inalámbrica de www.laerdal.com/SimNewB
- Para sacar el máximo partido de la formación mediante simulación, descargue aquí los escenarios complementarios: www.laerdal.com

Elementos incluidos y almacenamiento

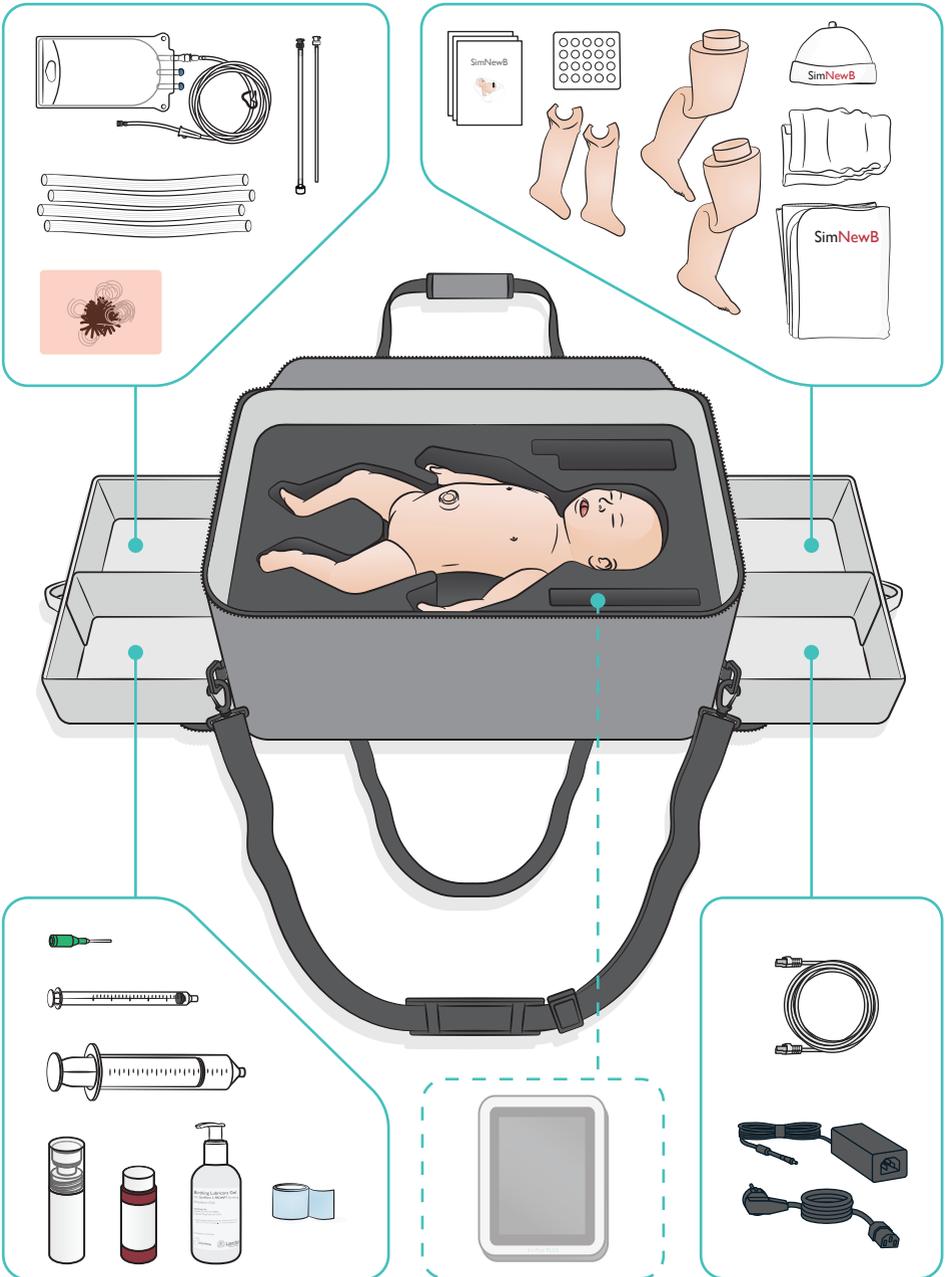

Características de la vía aérea

- Vía aérea anatómicamente realista
- Inserción de tubos nasales y endotraqueales orales
- Inserción de la mascarilla laríngea
- Maniobra de Sellick
- Elevación y descenso bilateral y unilateral del tórax con ventilación con presión positiva
- Intubación del bronquio principal derecho
- Aspiración
- Resistencia pulmonar variable
- Inserción de sonda gástrica
- Distensión estomacal
- Maniobra de reclutamiento pulmonar

Características de la respiración

- Respiración espontánea con frecuencia y profundidad variables
- Elevación y descenso bilateral y unilateral del tórax
- Sonidos pulmonares normales y anómalos
- Sonidos pulmonares anteriores
- Sonidos respiratorios unilaterales
- Saturación de oxígeno simulada
- Toracocentesis unilateral
- Neumotórax

Características vasculares

- Acceso IO bilateral
- Cordón umbilical simulado
- Acceso umbilical
- Retorno de la sangre simulada con la canalización

Características circulatorias

- Pulso umbilical
- Pulso braquial bilateral
- Cianosis central


Características cardíacas

- Formación básica en RCP

Otras características

- Pupilas normales, dilatadas y contraídas
- Sonidos vocales, pulmonares y cardíacos
- Brazos - movimientos y convulsiones

Panel de alimentación


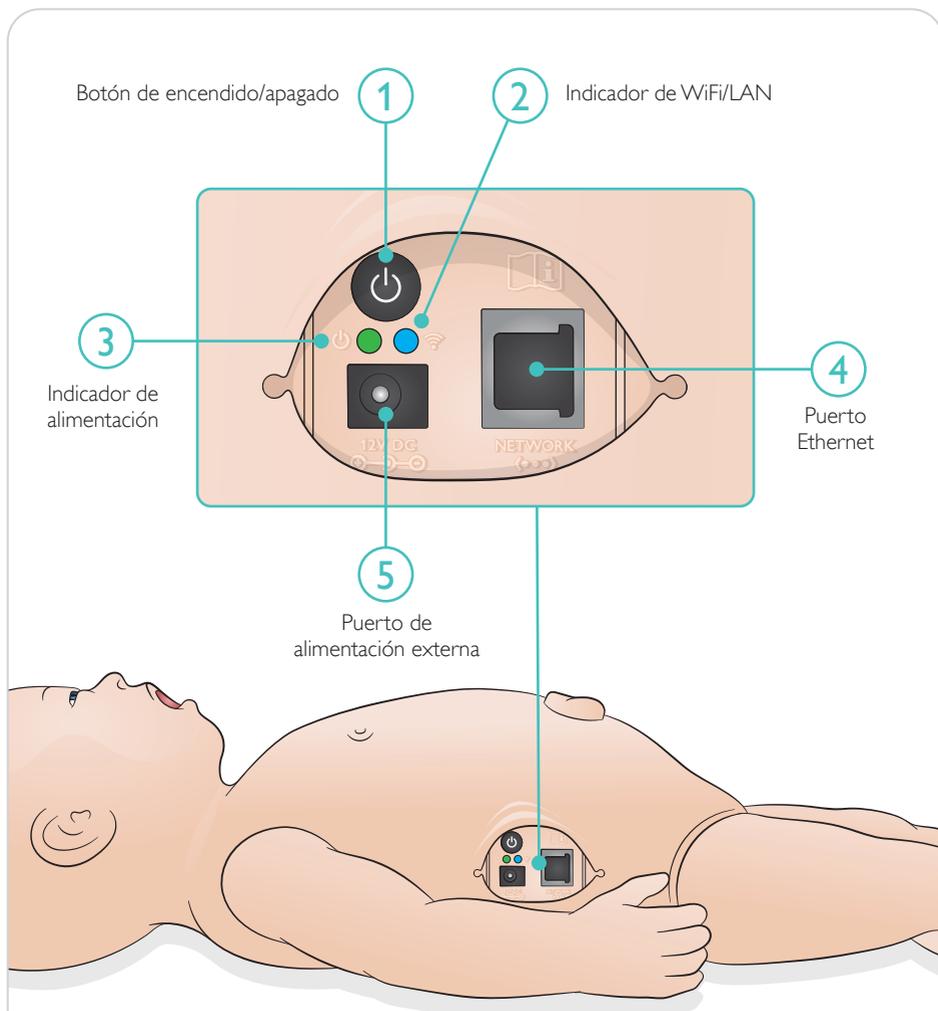


Estado del indicador de alimentación

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Encendido | Fallo al actualizar el software |
| Arranque del simulador | 10 segundos - batería baja |
| Actualización del software | Servicio requerido |
| Carga de la batería | Batería completamente cargada |

Cargue completamente la batería antes del primer uso.



-  Carga de la batería
-  Batería completamente cargada
-  10 segundos - batería baja

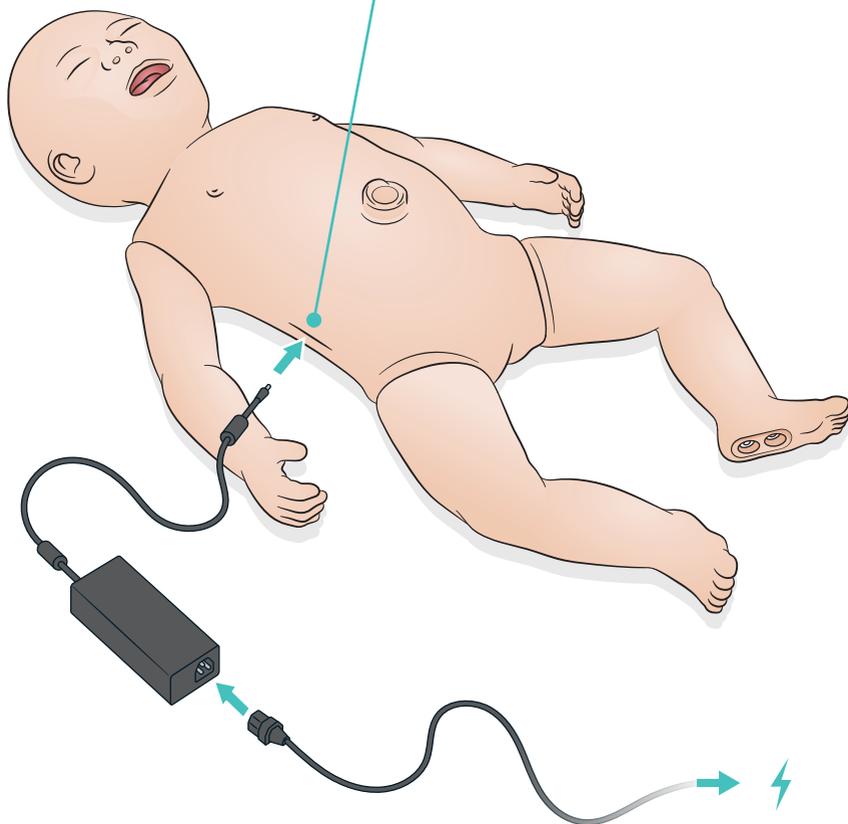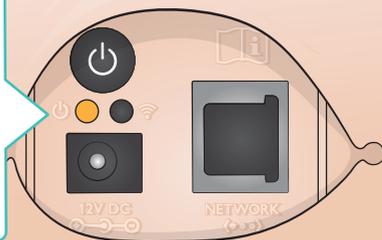

Conexión

Conexión a LLEAP o SimPad PLUS por WiFi.

- WiFi activada
- WiFi conectada al dispositivo
- Sin conexión - configurar red con cable Ethernet

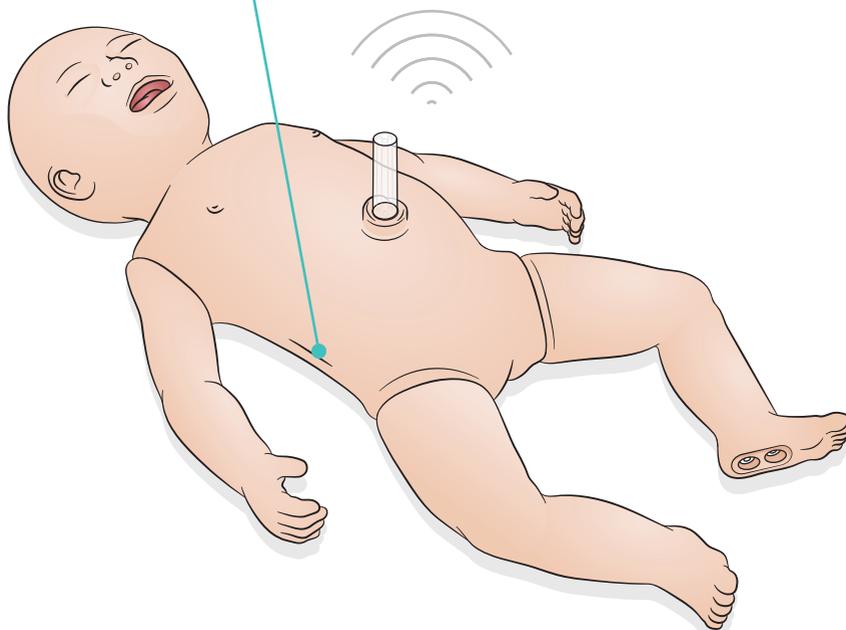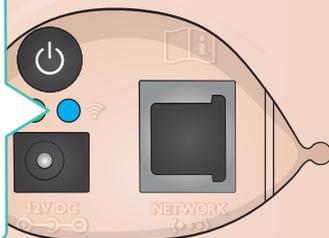

Nota


Para obtener instrucciones de conexión detalladas, descargue la sección de la descripción general de la configuración inalámbrica de www.laerdal.com/SimNewB

Descripción general de los pulsos y los sonidos

Los pulsos y sonidos se controlan en SimPad PLUS o LLEAP.

 Pulsos umbilical y braquial

 Sonidos vocales, pulmonares y cardiacos

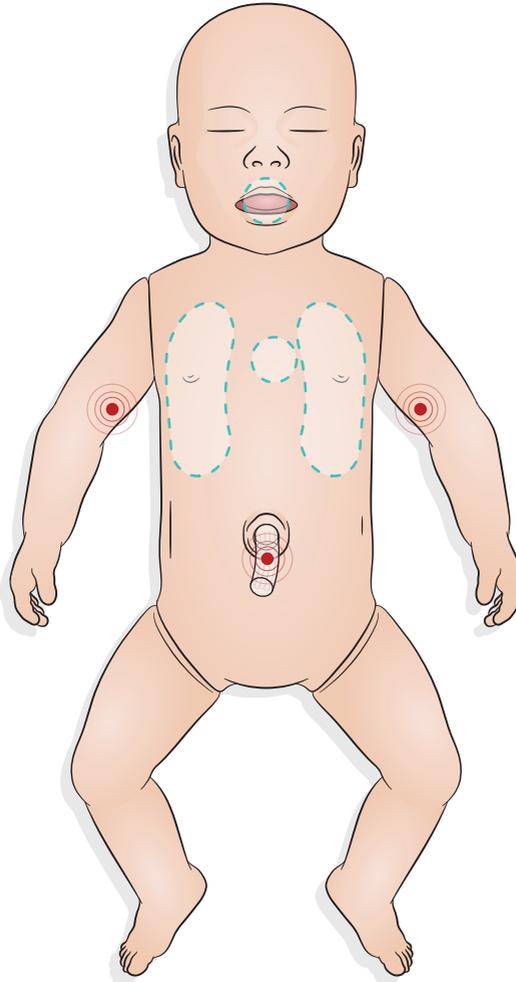

Preparación para simulación - Inserción del módulo de meconio

- Inserte el módulo con un dedo; no emplee la fuerza.
- Un catéter de succión a 100 mmHg eliminará el módulo de meconio.
- Se ha añadido un cabo para garantizar la retirada del objeto.

Notas

- *No añada lubricante al módulo.*
- *No inserte el módulo de meconio más allá de la campanilla.*



Preparación de la simulación - Cateterismo venoso umbilical


1

Coloque la punta y llénelo con 1 ml de sangre como máximo.




2

Inserte la sangre en el depósito.

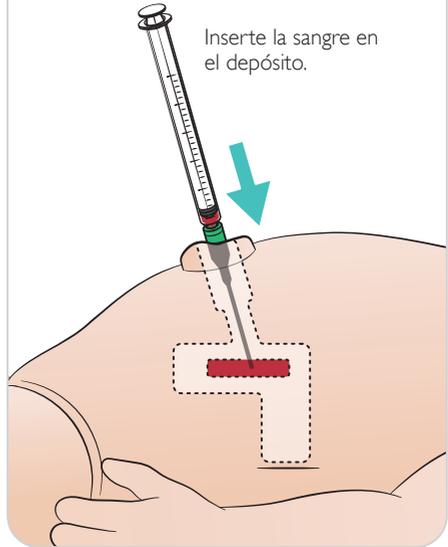


3

Coloque el cordón umbilical en el ombligo.

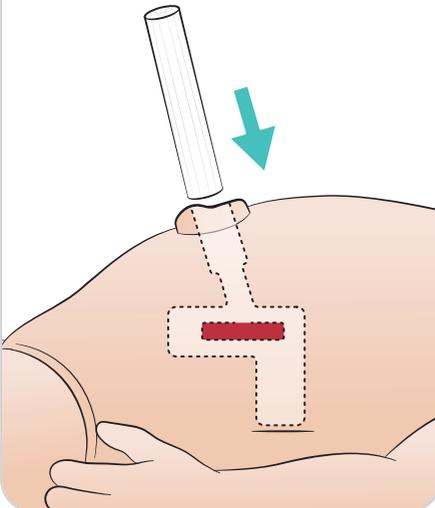

4

Gírelo para bloquearlo en su lugar.

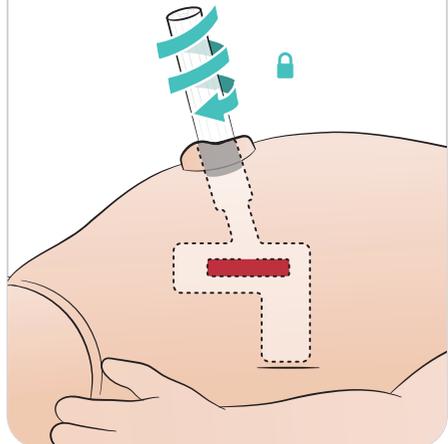


Preparación de la simulación - Cateterismo venoso umbilical


Infusiones de grandes volúmenes

Si el escenario requiere infusiones de grandes volúmenes de líquidos (de más de 10 ml), conecte al simulador una bolsa de drenaje vacía.

1


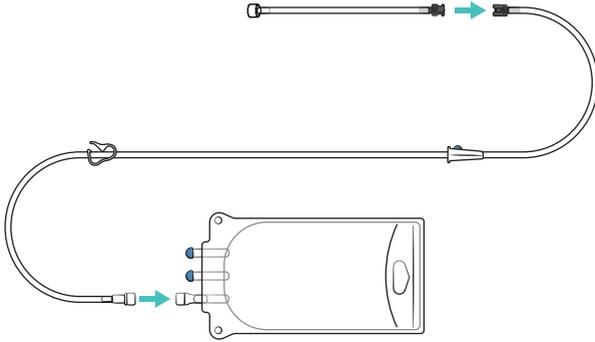


2

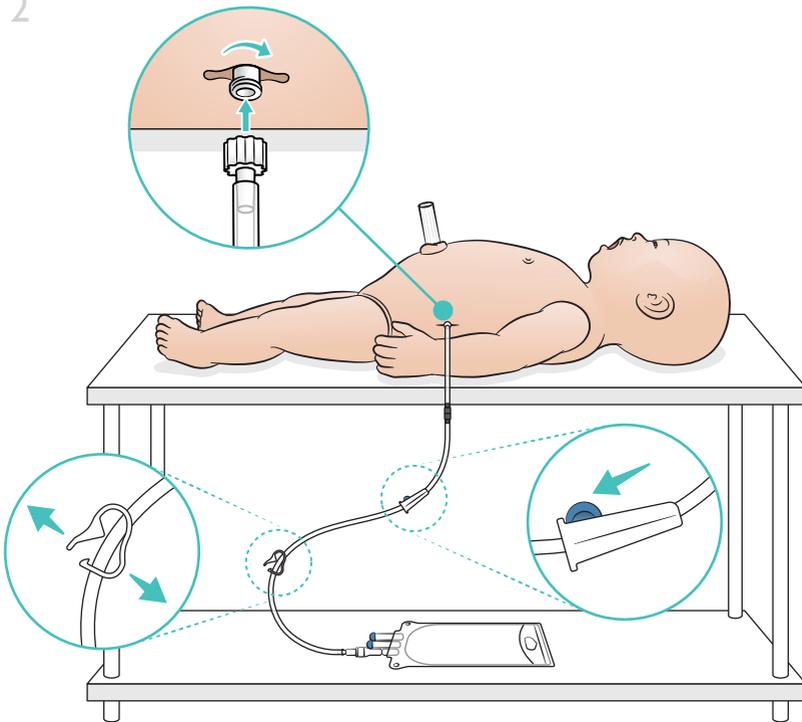


Preparación para la simulación - Pierna para tratamiento intraóseo - Infusiones de grandes volúmenes

Conecte una bolsa de drenaje vacía para preparar una infusión intraósea de un gran volumen de medicamento.

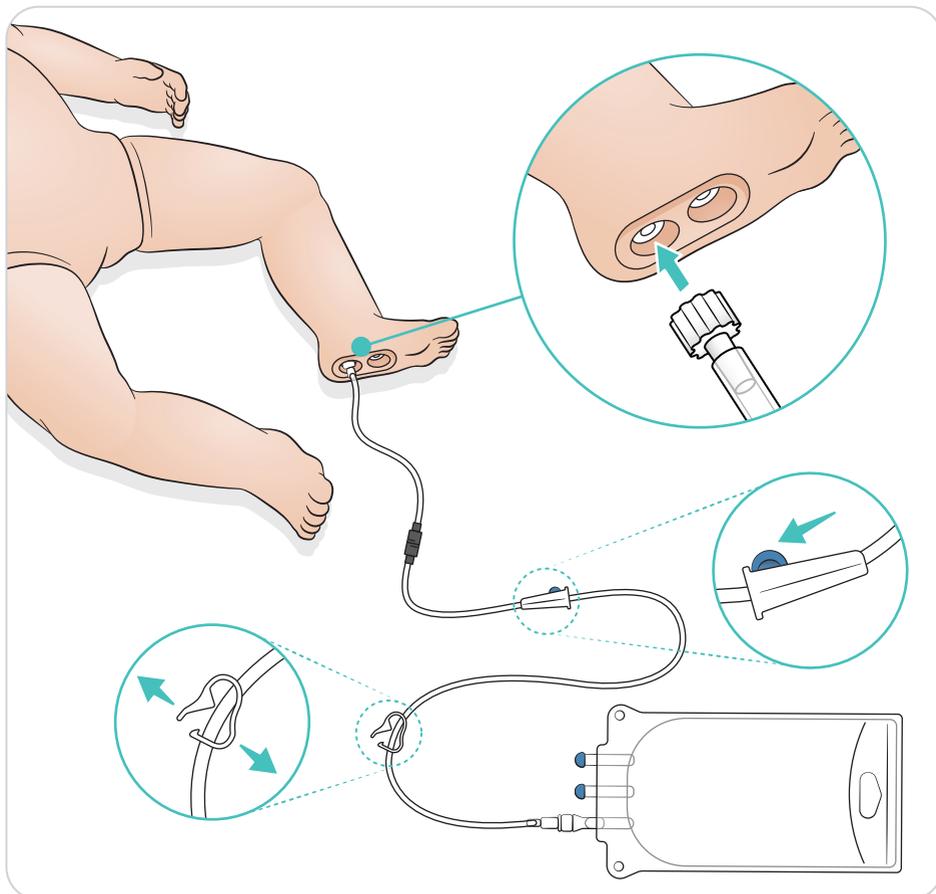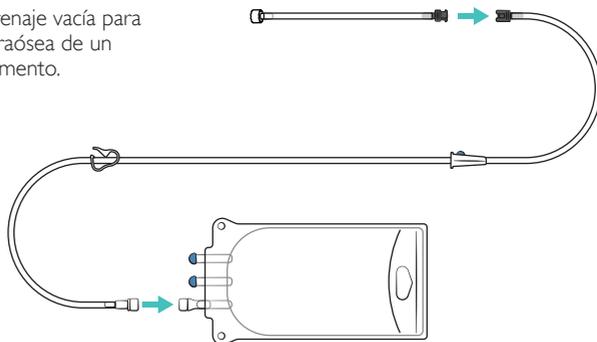

Preparación de la simulación - Selección de las pupilas


Gire los ojos para elegir el tipo de pupila.

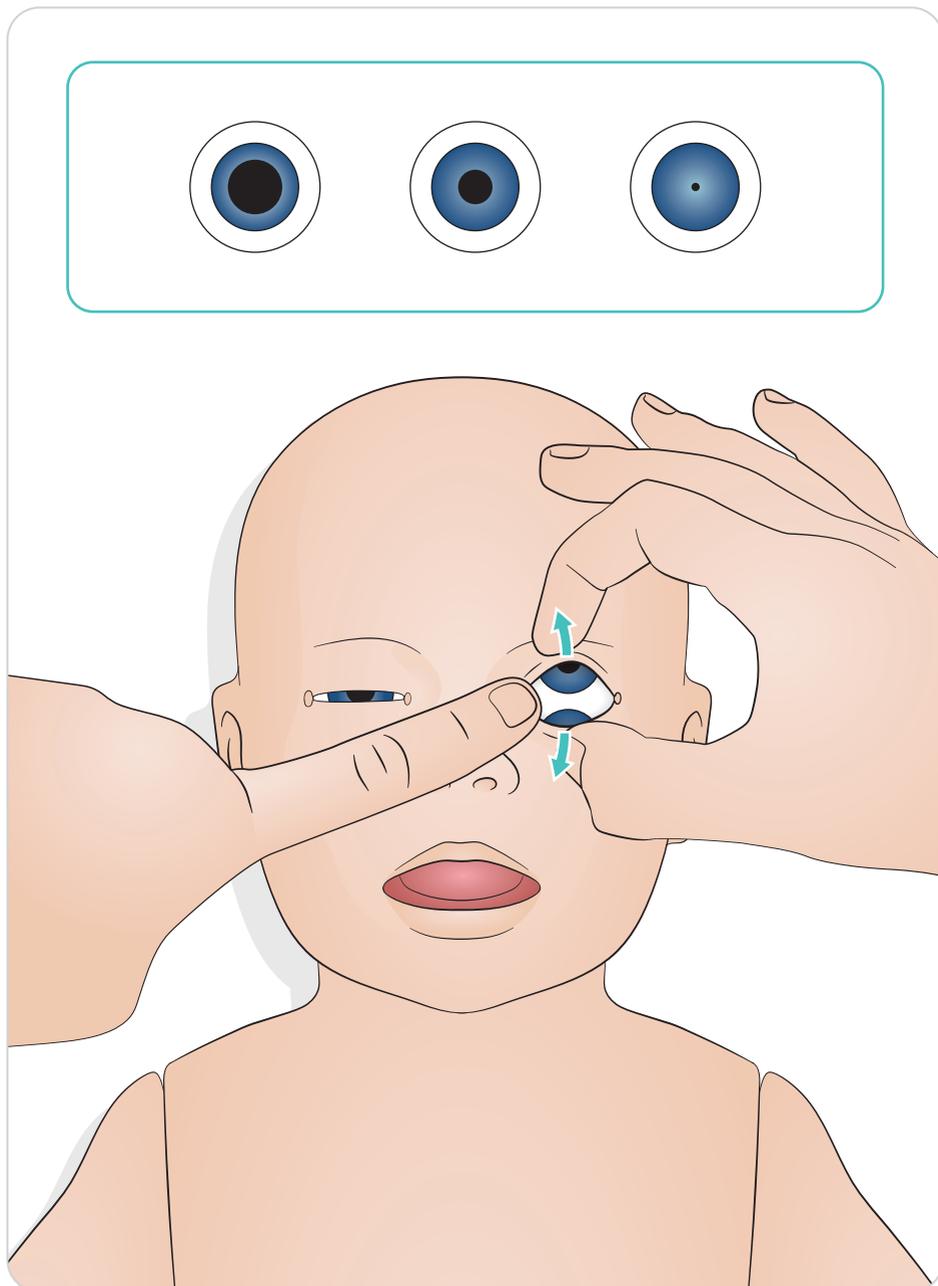

Preparación para la simulación - Lubricación

Lubricación de las herramientas

Lubrique la hoja de laringoscopio y los tubos antes de insertarlos en la vía aérea. Los instrumentos y tubos no lubricados también pueden dañar las vías aéreas. Utilice únicamente Silicone Lubricant proporcionado por Laerdal Medical.

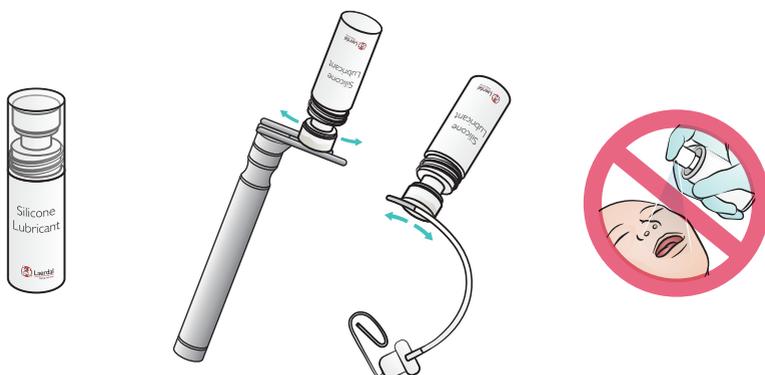




Lubricación de SimNewB

Lubrique la parte frontal del simulador antes de los escenarios de parto. Utilice únicamente el lubricante para el parto proporcionado por Laerdal Medical.






Uso - Intubación

Realice la intubación oral o nasal.

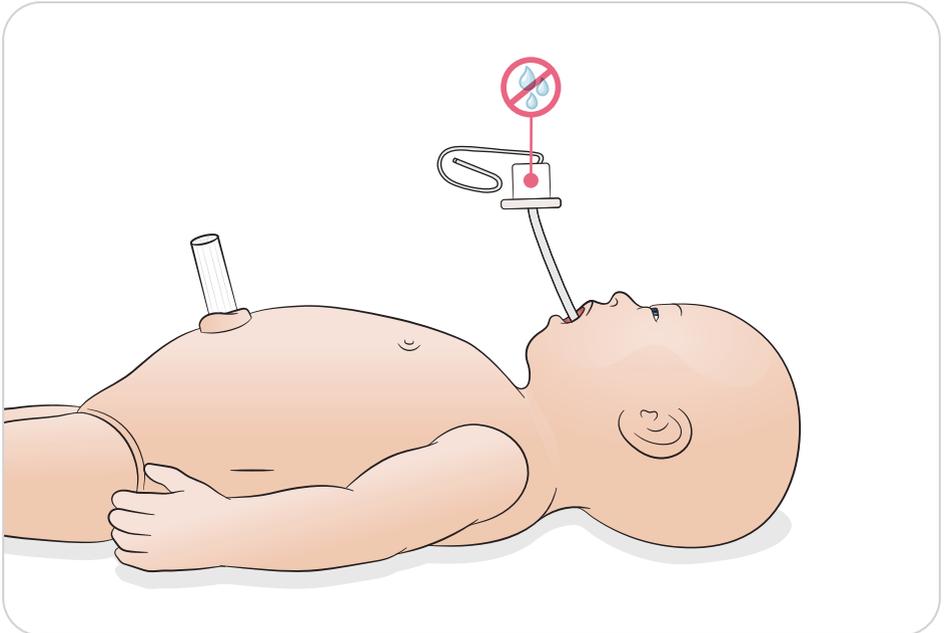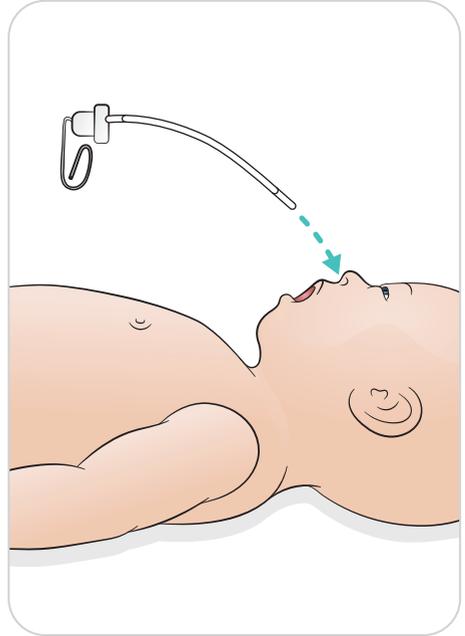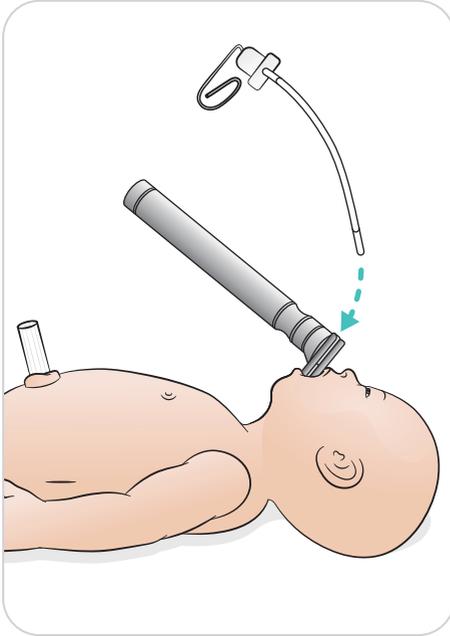


Realice las ventilaciones con una elevación del tórax visible.

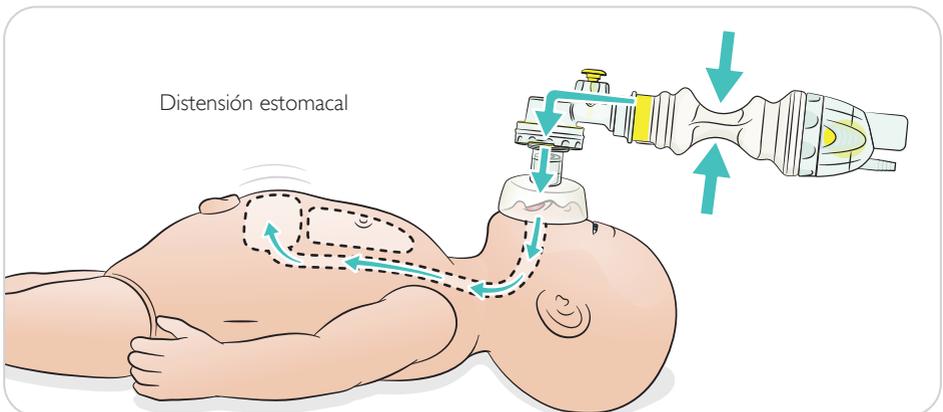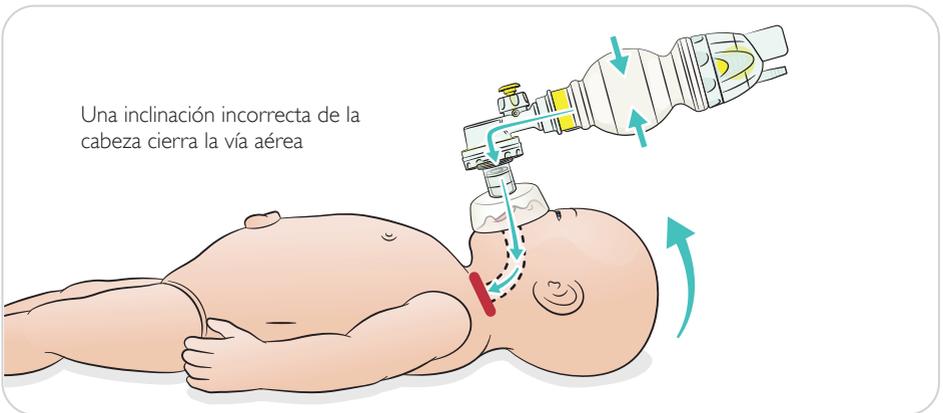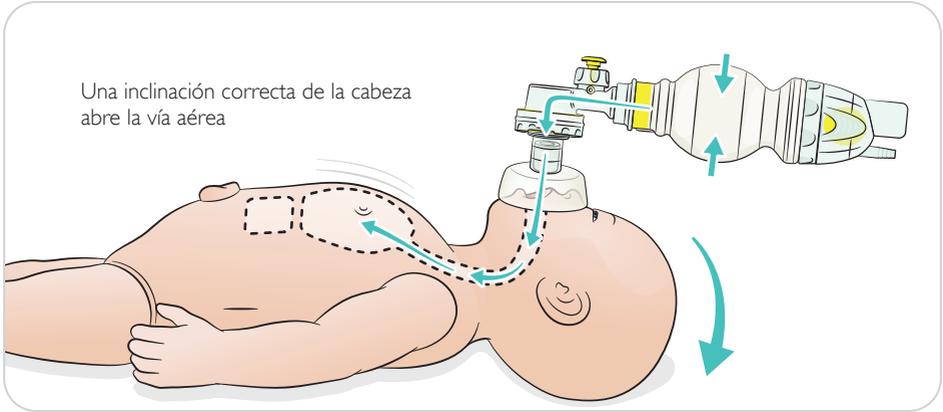


Uso - RCP

Realice la RCP básica.

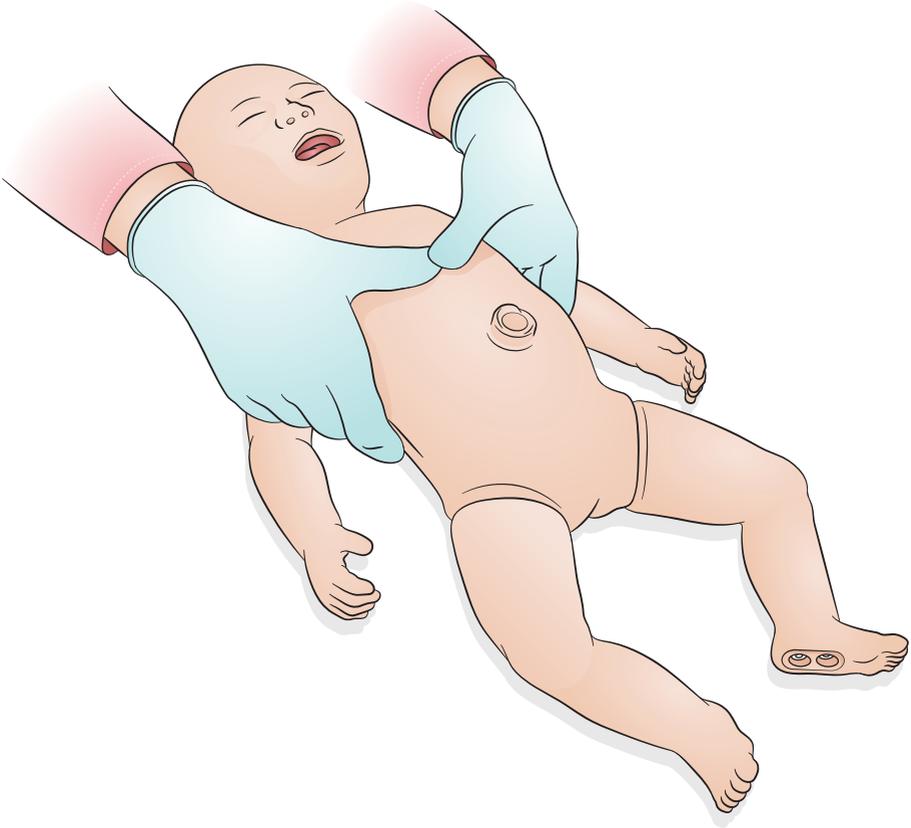

Uso - Acceso axilar medio para toracocentesis izquierda unilateral


Inserte la aguja en el espacio intercostal entre las costillas 4.º y 5.º.

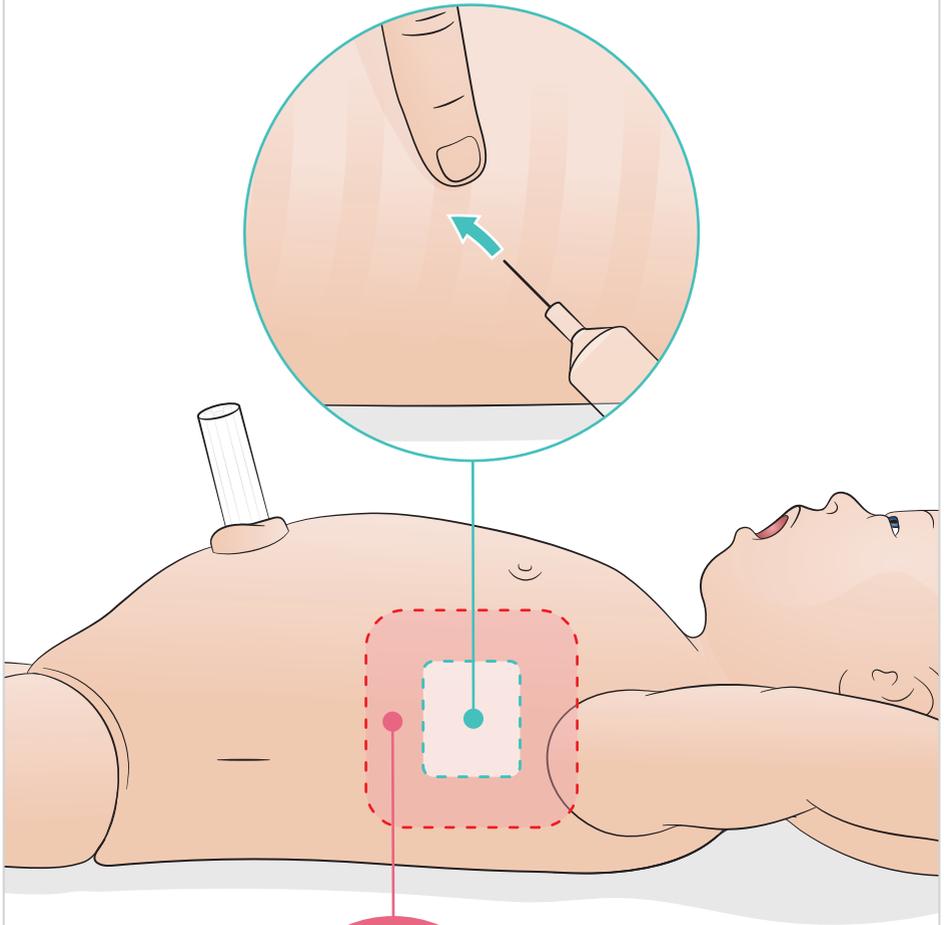

⚠ Precaución
La inserción de la aguja fuera de esta área puede causar daños al simulador.


Uso - Cateterismo venoso umbilical

Cordón umbilical simulado con acceso venoso y arterial.
Retorno de la sangre simulada con la canalización.

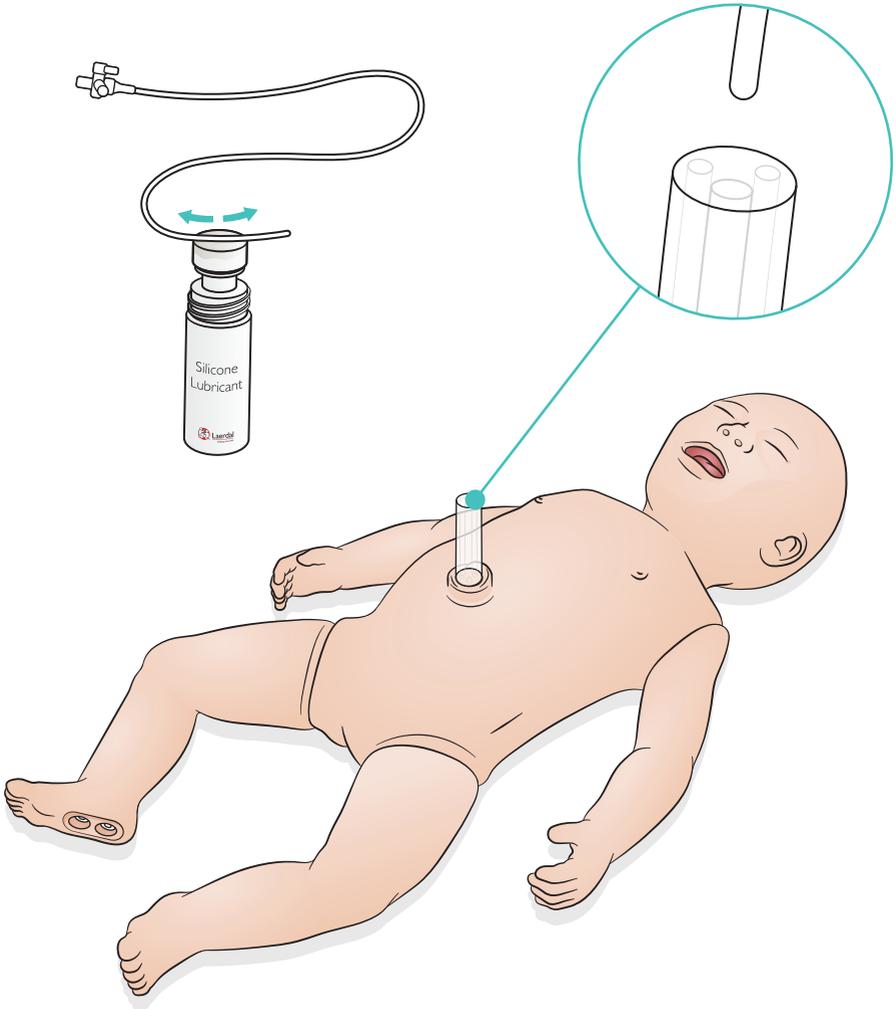

Uso - Infusiones de grandes volúmenes


Para infusiones de grandes volúmenes de líquidos (de más de 10 ml), conecte al simulador una bolsa de drenaje vacía.

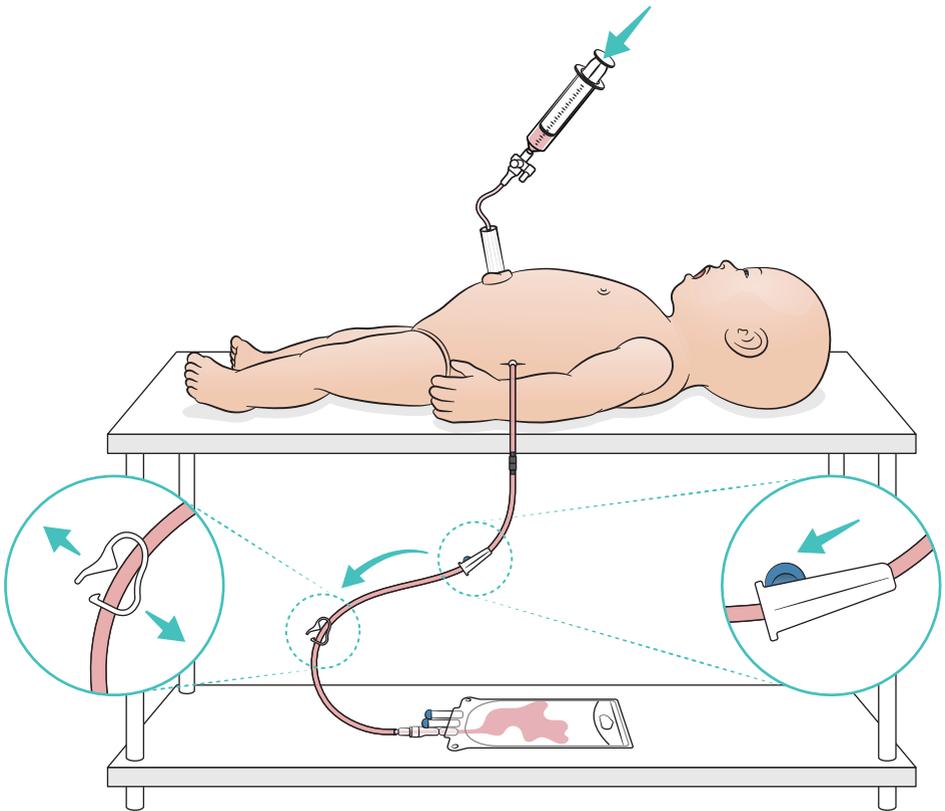

Uso - Pierna para tratamiento intraóseo

Nota

La pierna para tratamiento intraóseo se debe reparar o reemplazar tras cada simulación al utilizar fluidos.

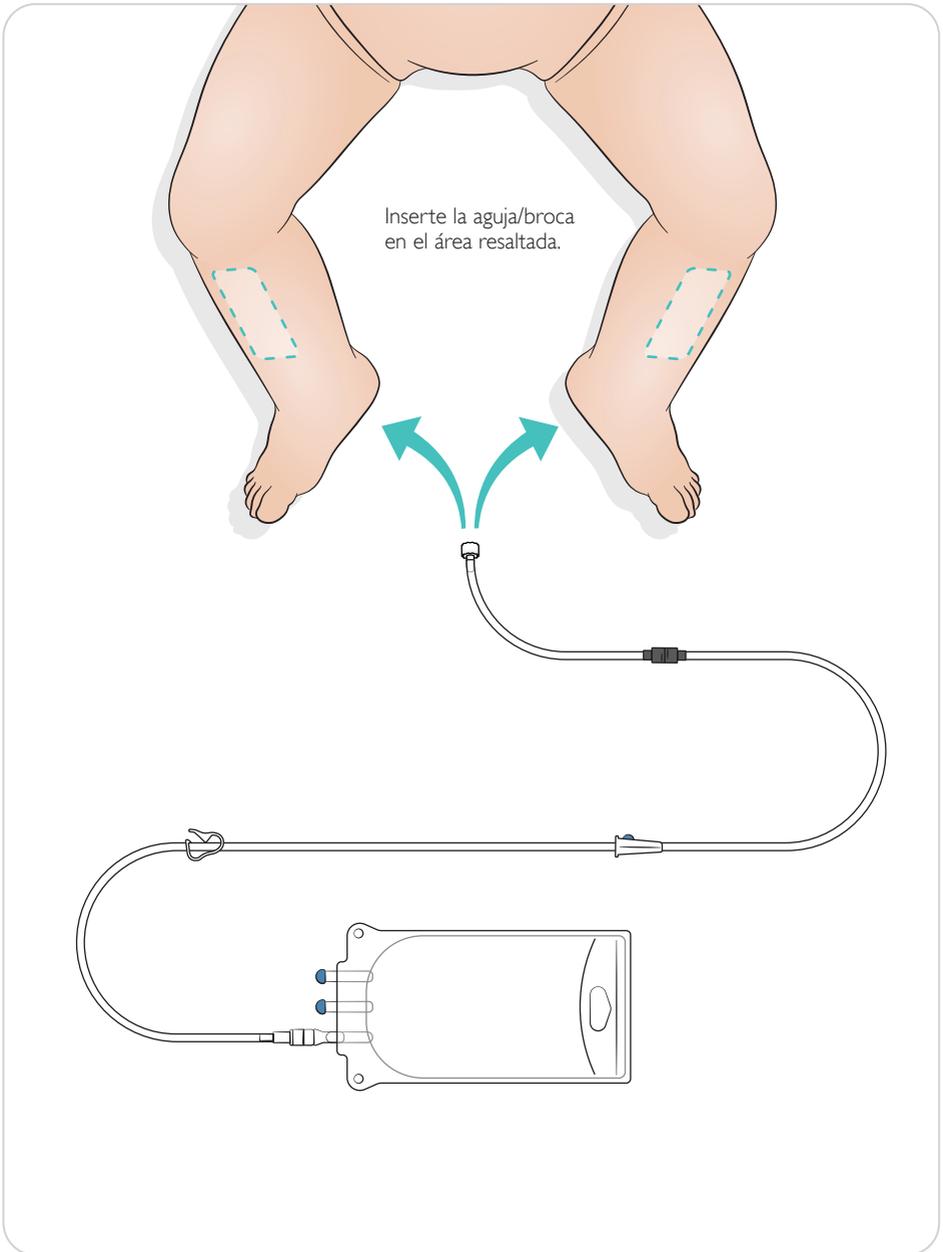

Uso - Ajustes de reclutamiento pulmonar

Ajustes de reclutamiento pulmonar

Cambie entre 4 y 7 respiraciones de apertura antes de iniciar la sesión.

SimPad Plus

Active el reclutamiento pulmonar en modo manual antes de iniciar el escenario.


The image displays three sequential screenshots of the SimPad Plus interface, illustrating the steps to activate lung recruitment. The background screenshot shows the main dashboard with vital signs: Sinus (ECG), HR 140, SpO₂ 98, RR 40, and etCO₂ 34. The middle screenshot is a 'Lung Recruitment' dialog box with the title 'Number of Effective Ventilations' and options for 'None', '4', and '7'. The bottom screenshot shows the 'Ongoing care' section with 'Lung Recruitment Ongoing' and a 'START' button.

1. Pulsar
2. Seleccionar número de ventilación
3. Pulsar
4. Iniciar


Uso - Ajustes de reclutamiento pulmonar

LLEAP

Active el reclutamiento pulmonar en modo manual antes de iniciar el escenario.

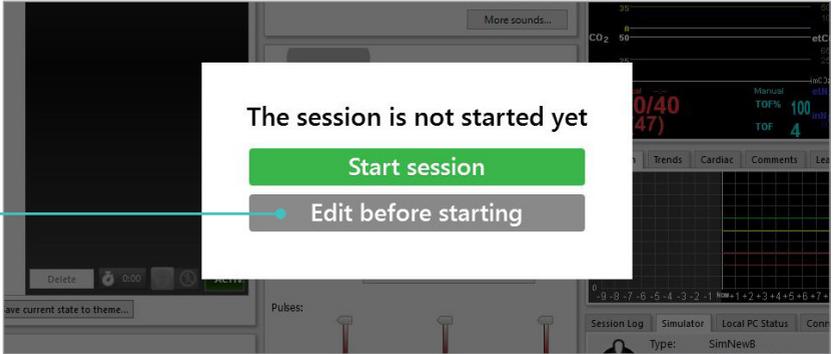

1. Pulsar

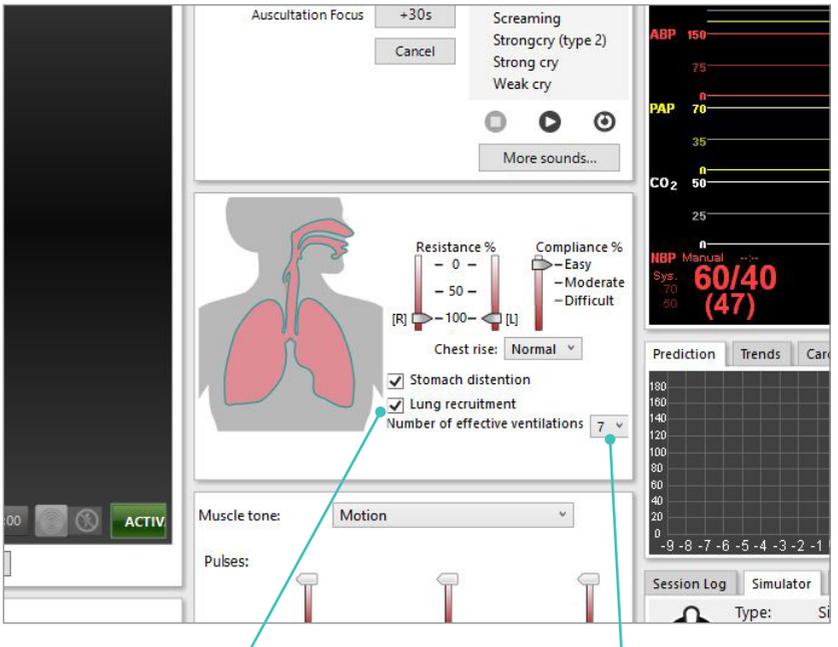

2. Comprobar este cuadro para interactuar con el reclutamiento pulmonar


3. Seleccionar número de ventilación

Ajustes de nivel


Utilice niveles para simplificar el funcionamiento al ejecutar sesiones en modo manual. Cada nivel 0 - 5 representa un conjunto de constantes vitales predefinidas.

Cambie directamente de un nivel a otro a medida que la sesión avanza para cambiar el estado clínico de SimNewB.

SimPad Plus

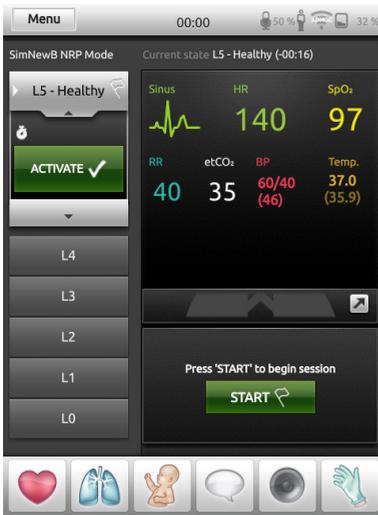

LLEAP

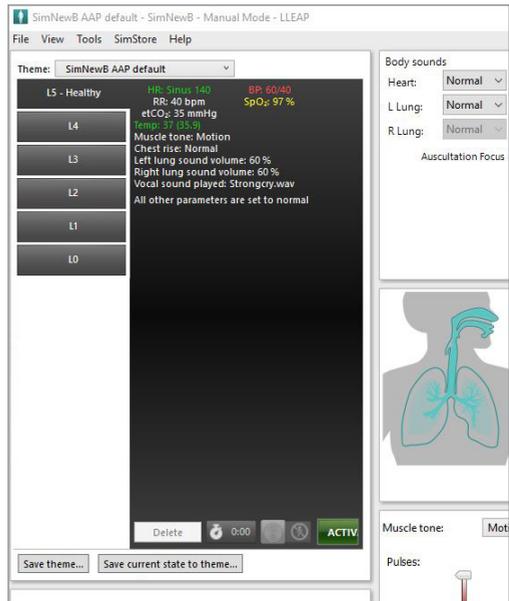

Cuidado y limpieza

Cuidado general

- Para mantener las pieles de los simuladores, lávese las manos antes del uso y coloque el simulador sobre una superficie limpia.
- Utilice guantes durante los escenarios de simulación. Evite utilizar guantes plásticos de color, ya que pueden provocar un cambio de color de la piel del simulador.
- Si durante la sesión de formación deben usarse líquidos en el depósito umbilical o la pierna para tratamiento intraóseo, drene el líquido inmediatamente después de la sesión de formación.

Piel

- Utilice un paño sin pelusa para eliminar el polvo y la suciedad.
- Limpie la piel con agua y jabón suave. No sumergir.
- Para quitar el lubricante para el parto, utilice agua templada con jabón.




Notas

Los siguientes elementos pueden decolorar el maniquí:

- *Pigmentos de barras de labios y bolígrafos*
- *Guantes de látex*
- *Uso de prendas diferentes a las que se incluyen originalmente con el simulador*

Limpeza del módulo de pierna para tratamiento intraóseo





Retire todo el líquido que quede en el depósito interno y lávelo con agua. Repita estos pasos hasta que esté limpio.

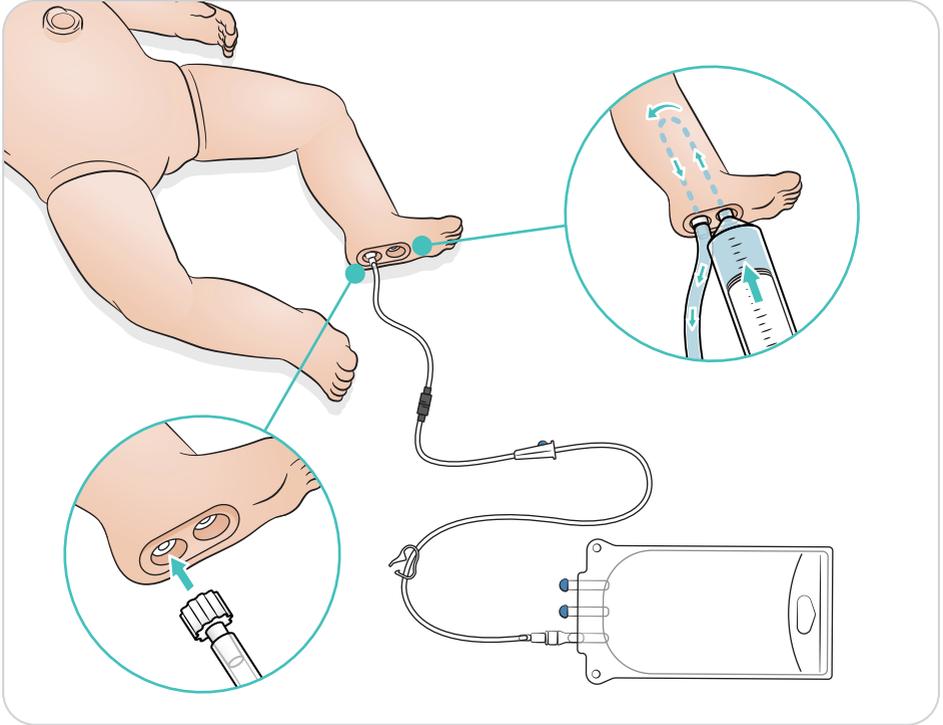

Cuidado y limpieza

Limpieza del depósito umbilical


Retire todo el líquido que quede en el depósito interno y lávelo con agua. Repita estos pasos hasta que esté limpio.

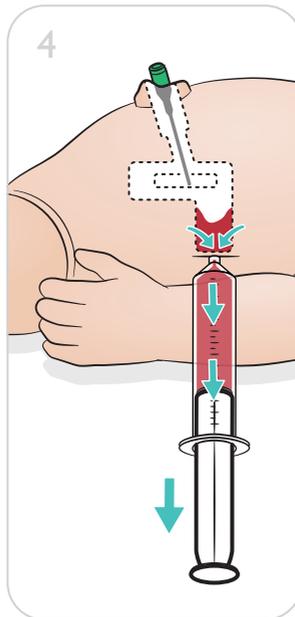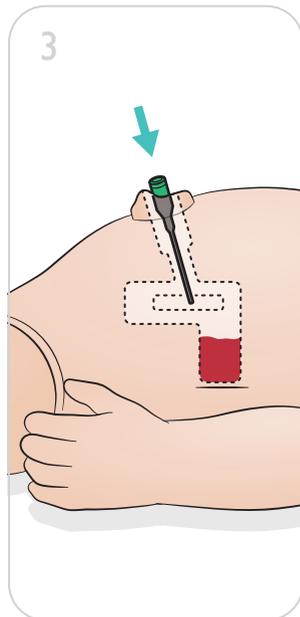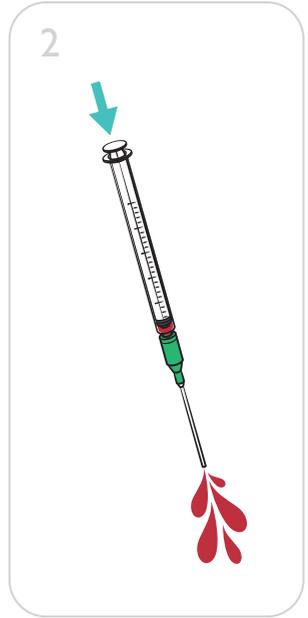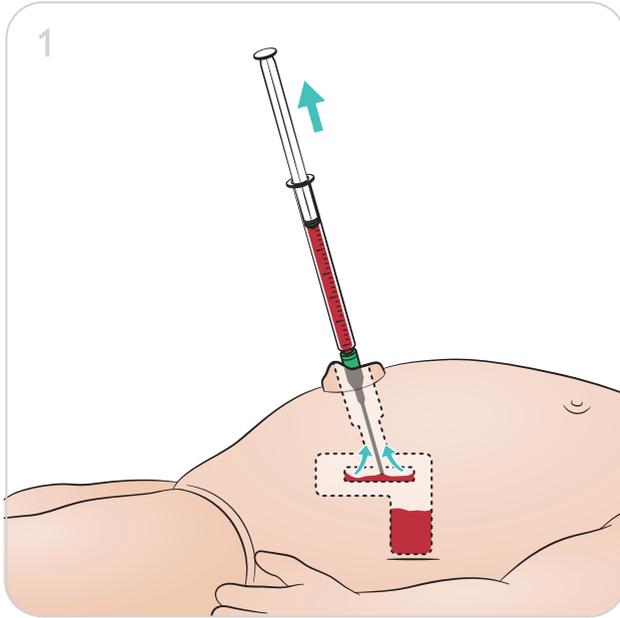


Nota

Saque la aguja del ombligo una vez que se complete el procedimiento de limpieza.


6

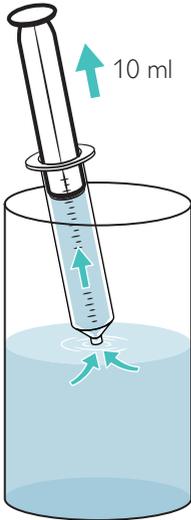


7

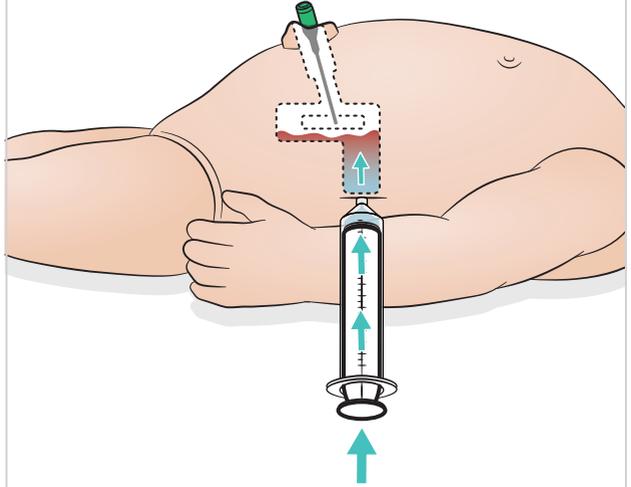

8

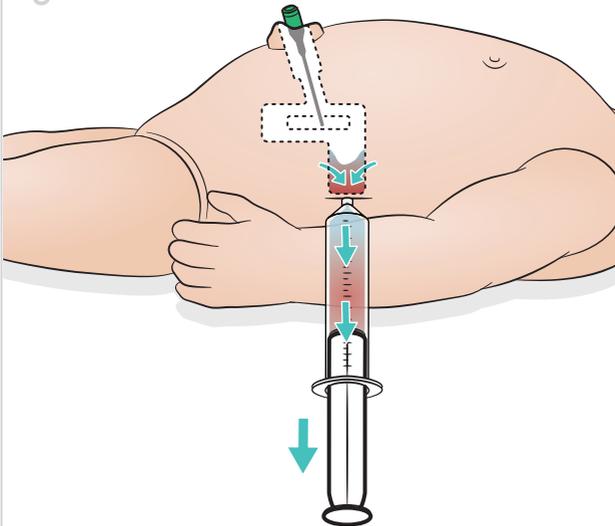

9




Mantenimiento


Reparación del módulo de la pierna para tratamiento intraóseo

Tras realizar los procedimientos intraóseos utilizando fluidos, limpie y repare o sustituya el módulo de la pierna para tratamiento intraóseo.


1

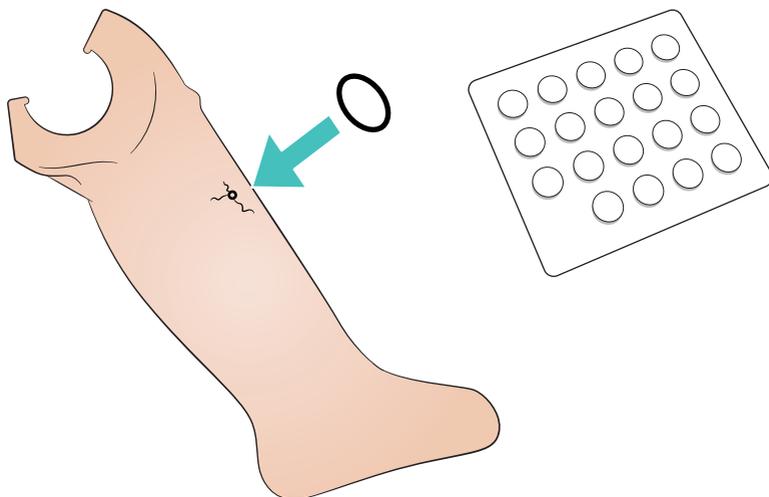

2



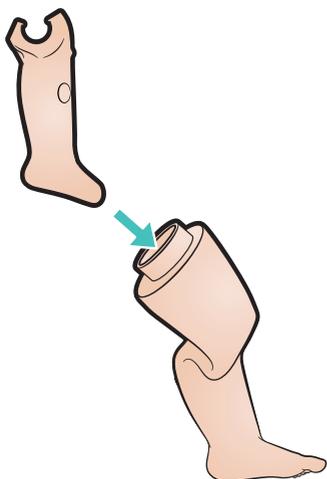


3

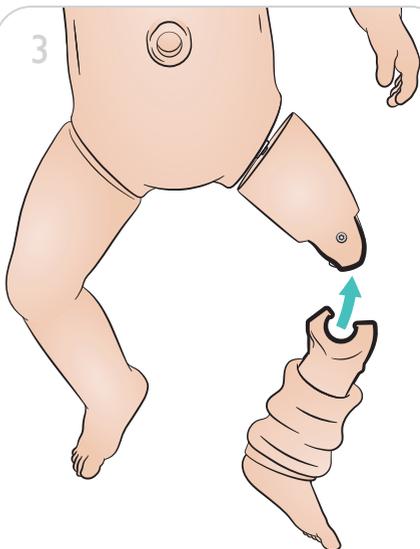

Mantenimiento

Retirada y reemplazo del módulo de la pierna para tratamiento intraóseo

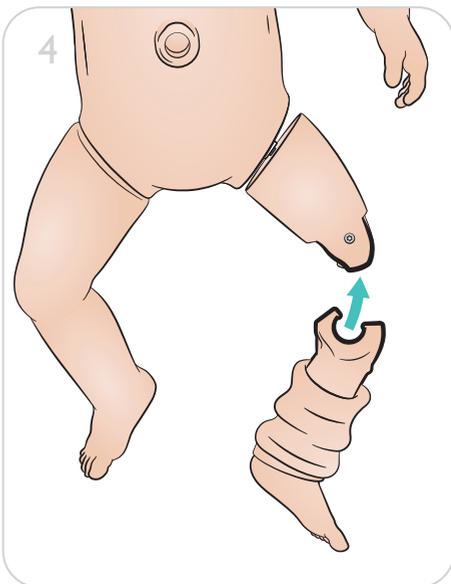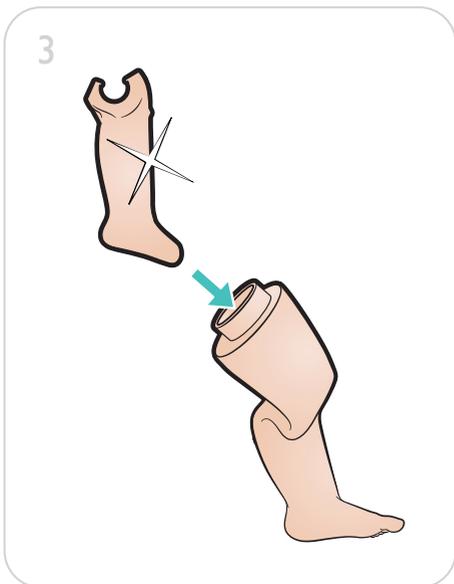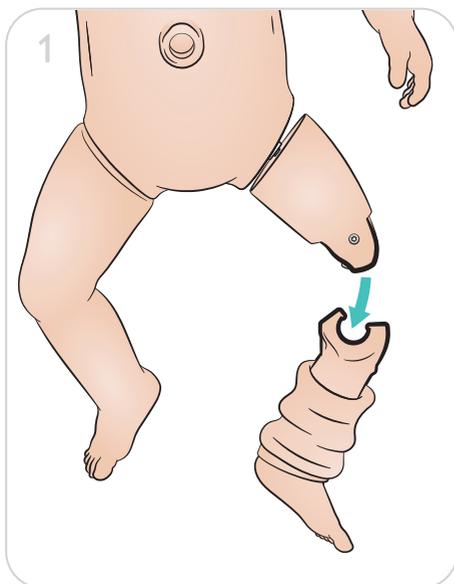





Para sacar el máximo partido de su producto, visite

www.laerdal.com/support



Descargas



Vídeos informativos



Guías del usuario




Lenguaje local



Preguntas más frecuentes



Servicio de atención al cliente



© 2019 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.

Fabricante: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tånke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Impreso en Noruega

20-16305 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives